



**Transmissor inteligente/
Cabeça Detectora de Gás**

SD-1DOX

Manual de instruções

(PT2E-179)

(PT2-179)

RIKEN KEIKI Co., Ltd.

2-7-6 Azusawa, Itabashi-ku, Tóquio, 174-8744, Japão

Telefone : +81-3-3966-1113

Fax : +81-3-3558-9110 GIII

E-mail : intdept@rikenkeiki.co.jp

Web site : <https://www.rikenkeiki.co.jp>

Precauções de operação

Este detector é um detector de deficiência de oxigênio que detecta o oxigênio no ar e aciona um alarme de deficiência de oxigênio.

O detector de deficiência de oxigênio é uma unidade de segurança, não um analisador ou densitômetro que realiza análises/medidas quantitativas/qualitativas de oxigênio.

Compreenda na íntegra os pontos seguintes antes de usá-lo, para que possa ser usado adequadamente.

1. As leituras do detector flutuam ligeiramente em resposta às mudanças na pressão do ar.
Em particular, tenha cuidado com a ativação do alarme quando uma baixa pressão de ar for trazida por tufão. Além disso, pode flutuar devido a alterações ambientais (temperatura, umidade, etc.) no local da instalação.
2. O alarme tem de ser definido dentro de uma faixa onde o desempenho do detector possa estar garantido.
O valor padrão do ponto de ajuste de alarme é 18 vol%.
3. Esta é uma unidade de segurança, não uma unidade de controle.
A saída de contato de alarme do detector deve ser utilizada para uma lâmpada/buzzer de alarme externo, enquanto a saída de sinal analógico deve ser utilizada para um indicador ou gravador externo.
4. Para manutenção do detector, este tem de submeter-se a manutenção regular, incluindo a substituição e o ajuste das peças de substituição regular, conforme especificado no manual de instruções. Além disso, como se trata de uma unidade de segurança, é recomendável que seja feita uma manutenção regular e um ajuste de alcance a cada seis meses.

<Índice>

1	Esboço do produto	2
1-1.	Prefácio	2
1-2.	Uso previsto	2
1-3.	Definição de PERIGO, AVISO, CUIDADO e NOTA.....	2
1-4.	Método de confirmação para Normas e Especificações de proteção contra explosão	3
2	Avisos importantes sobre segurança.....	4
2-1.	Casos de perigo	4
2-2.	Casos de aviso.....	5
2-3.	Precauções	6
2-4.	Informação de Segurança	7
3	Componentes do produto.....	9
3-1.	Unidade principal e acessórios padrão	9
3-2.	Nomes e funções para cada peça.....	10
3-3.	Diagrama do bloco	11
4	Como usar.....	12
4-1.	Antes de utilizar o detector de gás	12
4-2.	Precauções para locais de instalação.....	12
4-3.	Precauções para a concepção do sistema	13
4-4.	Como instalar	16
4-5.	Procedimento de instalação.....	18
4-6.	Como ligar.....	20
4-7.	Como fazer a tubulação	24
5	Como utilizar	25
5-1.	Preparação para a partida.....	25
5-2.	Procedimentos de operação básicos	25
5-3.	Como ligar o detector de gás	26
5-4.	Modos	27
5-5.	Modo de manutenção (Usuário).....	28
5-6.	Como sair.....	30
6	Operações e funções	31
6-1.	Ativação do alarme.....	31
6-2.	Ativação do alarme de falha	32
6-3.	Operação de saída externa.....	33
6-4.	Outras funções.....	34
7	Manutenção	35
7-1.	Intervalos e itens de manutenção	35
7-2.	Modo de manutenção (manutenção regular)	37
7-3.	Método de calibração	44
7-4.	Peças de reposição.....	47
8	Armazenamento, recolocação e eliminação.....	48
8-1.	Procedimentos para armazenar o detector de gás ou deixá-lo fora de serviço durante um período longo	48
8-2.	Procedimentos para realocar o detector ou usá-lo novamente.....	48
8-3.	Eliminação de produtos.....	48
9	Resolução de problemas.....	49
10	Especificações do produto	51
10-1.	Lista de especificações	51
10-2.	Princípio de detecção.....	59
11	Definição de termos.....	60

1

Esboço do produto

1-1. Prefácio

Obrigado por ter escolhido o nosso transmissor inteligente/cabeça detectora de gás SD-1DOX. Verifique se o número do modelo do produto que adquiriu está incluído nas especificações deste manual.




Este manual explica como utilizar o detector e as suas especificações. Contém informações necessárias para utilizar adequadamente o detector de gás. Não só os usuários iniciantes, mas também os usuários que já usaram o produto devem ler e entender o manual de instruções para aprimorar o conhecimento e a experiência antes de usar o detector.

Este manual fornece explicações usando a especificação O₂ (faixa de detecção de 0 - 25 vol%) como exemplos (como exemplos do visor LED).

1-2. Uso previsto

- Este detector é do tipo fixo que detecta o oxigênio e executa a ativação do alarme quando a concentração de gás está acima do valor de ajuste.
O detector é uma unidade de segurança, não um analisador ou densitômetro que executa medições análises qualitativas/quantitativas para gases. Compreenda na íntegra as características do detector antes de usá-lo, para que possa ser usado adequadamente.
- O detector detecta anomalias no ar causadas pela presença de gases ou outros motivos (vazamento) com o sensor de gás integrado. As concentrações de gases detectados são exibidas no LED de sete segmentos.
- Uma bomba externa, etc. fora do detector introduz gás para realizar a detecção de gás.
- O detector tem um contato de alarme integrado e pode ser usado como um alarme de gás, alarme de falha ou alarme comum (gás, falha).
- O detector faz sair a concentração de gás em 4 - 20 mA.


1-3. Definição de PERIGO, AVISO, CUIDADO e NOTA

 PERIGO	Esta mensagem indica que o manuseio inadequado pode causar danos graves para a vida, saúde ou propriedade.
 AVISO	Esta mensagem indica que o manuseio inadequado pode causar danos graves para a saúde ou propriedade.
 CUIDADO	Esta mensagem indica que o manuseio inadequado pode causar danos menores para a saúde ou propriedade.
NOTA	Esta mensagem indica aconselhamento sobre o manuseio.

1-4. Método de confirmação para Normas e Especificações de proteção contra explosão


Este produto tem algumas especificações que dependem da norma e do certificado contra explosão. Confirme a especificação do detector antes de usar. Consulte a Declaração de Conformidade que se encontra no final deste manual se tiver o tipo de marcação CE. Pode-se confirmar a especificação do instrumento para ver a placa do nome conforme segue.

Marcação Ex

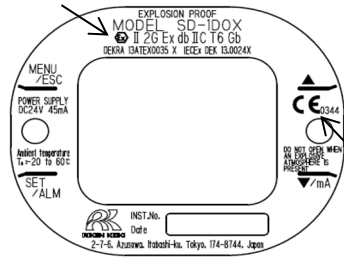


Marcação CE

Certificado Japan Ex

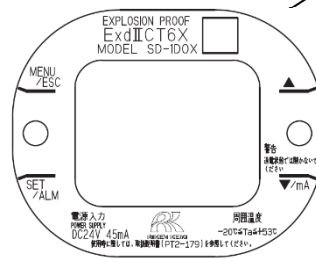

ATEX/IECEx, CE placa do nome do tipo de marcação CE

Placa do nome de tipo Japan Ex

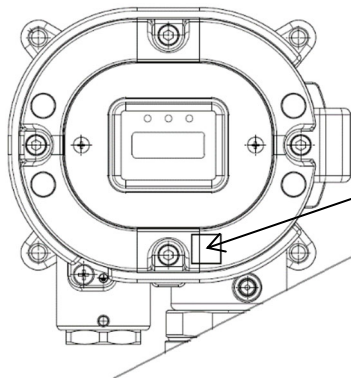

Certificado INMETRO

INMETRO, placa de identificação de

2

Avisos importantes sobre segurança

2-1. Casos de perigo



PERIGO

Sobre a proteção contra explosão

- O material da placa do vidro é uma resina de policarbonato. Não use solventes orgânicos nem tipos alcalinos (líquidos ou gasosos). Pode causar alterações na cor e na forma da placa do vidro.
- Não abra a tampa com corrente aplicada.
- Não tente reparar o detector.
- Para a tampa, use parafusos de cabeça sextavada especificados pela RIKEN KEIKI.
- Não aplique força ou choque fortes na placa do vidro. Os desempenhos da proteção contra explosão podem deteriorar-se devido a danos. As condições de proteção contra explosão para o detector é possibilidade de danos mecânicos “baixa (2J)”.
- Temperatura ambiente:
Especificações ATEX/IECEX/INMETRO: -20 - +60 °C
Especificações Japan Ex: -20 - +53 °C
(A temperatura ambiente na certificação à prova de explosão é descrita acima e indica a faixa de temperatura que pode manter o desempenho à prova de explosão e não o desempenho do produto, ver '10-1. Lista de especificações' para detalhes).
- Não substitua peças a seu próprio critério, mas contacte a RIKEN KEIKI se o vidro transparente tiver uma fenda ou se a superfície de união da proteção contra explosão estiver anormal, ou o parafuso de fixação ou o parafuso se tiver alterado, perdido, etc.
- Não repare a superfície de união da proteção contra explosão.
- Tenha cuidado para não bater com ferramentas afiadas contra a placa do vidro.

2-2. Casos de aviso



AVISO

Fonte de alimentação

Antes de ligar o detector, verifique sempre se a voltagem está aplicada adequadamente. Não use uma fonte de alimentação instável porque pode causar anomalias.

Necessidade de circuito de aterramento

Não corte o circuito de aterramento nem desconecte o fio do terminal de aterramento.

Defeitos nas funções de proteção

Antes de iniciar o detector, verifique as funções de proteção quanto a defeitos. Quando detectar defeitos aparentes nas funções de proteção, tais como aterramento protetor, não inicie o detector.

Conexão externa

Antes de conectar o detector ao circuito de controle externo, conecte firmemente um circuito de aterramento protetor.

Tubulação

O detector está concebido para arrastar gases em torno do mesmo abaixo da pressão atmosférica. Certifique-se de que a pressão excessiva não seja aplicada à entrada e saída de amostragem (GAS IN, GAS OUT) do detector. Os gases detectados devem ser exauridos da saída de exaustão de gás detectado (GAS OUT) ao qual um tubo de exaustão está conectado, até um ponto considerado como um local seguro.

Ajuste de amplitude (ajuste AIR) na atmosfera

Quando o ajuste da amplitude (ajuste AIR) é realizado na atmosfera, verifique se a atmosfera está fresca antes de iniciar o ajuste. Se existem gases de interferência, o ajuste não pode ser realizado adequadamente, levando assim a perigos quando a concentração de oxigênio flutua.

Resposta a alarme de gás

A emissão de um alarme de gás indica que existem perigos extremos. Tome as ações adequadas com base no seu bom senso.

Manuseio do sensor

Não desmonte o sensor usado pelo detector porque ele contém eletrólito. O eletrólito pode causar queimaduras da pele graves se entrar em contato com a pele, podendo causar cegueira se entrar em contato com os olhos. Se o eletrólito aderir a suas roupas, essa parte de suas roupas fica descolorida ou o seu material decompõe-se. Se ocorrer contato, lave imediatamente a área com muita água.

2-3. Precauções



CUIDADO

Não use um transceptor perto do detector.

As ondas de rádio de um transceptor ou outro dispositivo de transmissão de ondas de rádio próximo ao detector ou seus cabos podem perturbar as leituras. Se usar um transceptor ou outro dispositivo transmissor de ondas de rádio, este deve ser usado em um local onde não cause perturbações.

Para reiniciar o detector, aguarde cinco segundos ou mais, antes de fazê-lo.

Reiniciar o detector em menos de cinco segundos pode causar erros.

Verificar se a vazão corresponde à vazão especificada antes de usar o detector.

Se não corresponder à vazão especificada, a detecção de gás não pode ser realizada adequadamente. Verificar se a taxa de fluxo é instável ou se perdeu.

Fixar o filtro de poeira antes de usar o detector.

Antes de usar o detector, fixar o filtro especificado para evitar distúrbios por possível adsorção de gás ou pó de ar.

Um filtro de pó a ser usado varia dependendo do gás a ser detectado. Para maiores informações sobre filtros de pó, entre em contato com a RIKEN KEIKI.

Observe as restrições operacionais para evitar a condensação no interior do tubo.

A condensação formada dentro do tubo causa entupimento ou adsorção de gás, o que pode perturbar a detecção precisa de gás. Assim, deve-se evitar a condensação. Além do ambiente de instalação, monitorar cuidadosamente a temperatura/umidade do ponto de amostragem para evitar a condensação dentro do tubo. Em particular, ao detectar um gás que é dissolvido em água e corrói materiais contatados, tais como um gás ácido forte, o gás é indetectável e, além disso, pode corroer as partes internas. Respeite as restrições de operação.

Não use a saída externa do detector para controlar outras unidades.

Esta não é uma unidade de controle. Não é permitido usar a saída externa do detector para controlar outras unidades.

Não desmonte/modifique o detector, nem altere as definições se não for necessário.

Desmontar/modificar o detector invalidará a garantia do desempenho. Alterar as definições sem compreender as especificações pode causar anomalias de alarme. Use o detector adequadamente de acordo com o manual de instruções.

Evite aplicar solventes orgânicos e outros na placa do vidro durante muito tempo.

O material da placa do vidro é uma resina de policarbonato. Quando se aplica solventes orgânicos (líquidos ou vapores altamente concentrados) e outros na placa durante muito tempo, a sua forma e cor podem alterar-se.

Efetue sempre uma manutenção regular.

Uma vez que esta é uma unidade de segurança, é necessário efetuar uma manutenção regular para manter a segurança. Continuar a usar o detector sem efetuar uma manutenção deteriorará a sensibilidade do sensor, resultando em detecção de gás imprecisa.

2-4. Informação de Segurança

Informação necessária para a construção contra explosão do Modelo SD-1DOX.

O Modelo SD-1DOX é uma cabeça do detector de monitoramento contínuo de apoio fixo e fornece um sinal de 4-20 mA que indica a leitura do gás pretendido para uso por um controlador de monitoramento de gás, dispositivo de registro, ou controlador programável.

Há um ponto de contato e funciona por aviso de gás ou problema ou ambos por ajuste.


<Especificações ATEX/IECEX>

Dados técnicos

(Método de proteção)	Invólucro à prova de fogo "d"
(Números de Certificado)	IECEX DEK 13.0024X DEKRA 13ATEX0035 X
(Grupo)	II
(Categoria)	2 G
(Tipo de proteção e Código de marcação)	Ex db IIC T6
(Nível de proteção do equipamento)	Gb
(Temperatura ambiente)*	-20 °C - +60 °C
(Dados elétricos)	Voltagem de alimentação: 24 V CC $\pm 10\%$ 45 mA Sinal de saída (4 - 20 mA): 24 V CC 22 mA Relé (saída de contato): 30 V CC ou 250 V CA 0,5 A
(Norma aplicável)	IEC 60079-0: 2017, IEC 60079-1: 2014-06 EN IEC 60079-0: 2018, EN 60079-1: 2014
(Número do Manual)	PT2E-179

* A temperatura ambiente na certificação à prova de explosão é descrita acima e indica a faixa de temperatura que pode manter o desempenho à prova de explosão e não o desempenho do produto, ver '10-1. Lista de especificações' para detalhes.

Instalação

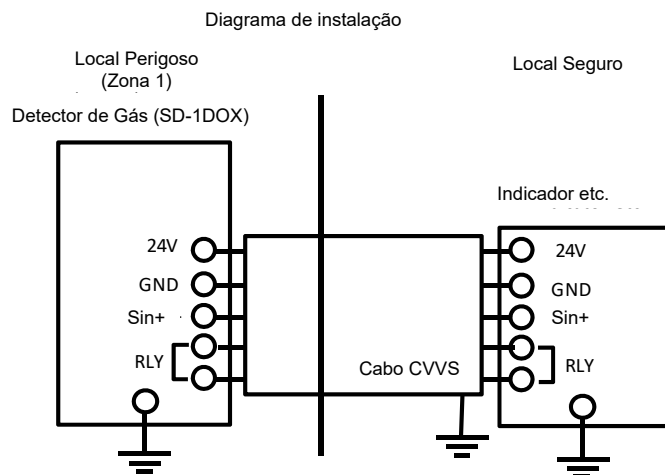


<Especificações Japan Ex>

Dados técnicos

(Método de proteção)	Invólucro à prova de fogo
(Classe contra explosão)	Ex d IIC T6 X
(Temperatura ambiente)*	-20 °C - +53 °C
(Dados elétricos)	Voltagem de alimentação: 24 V CC \pm 10 % 45 mA
	Sinal de saída do elemento de detecção: 0,1 V CC 0,2 mA
	Saída de sinal analógico: 24 V CC 22 mA
	Saída de contato (capacidade de contato): 250 V CA 0,5 A (resistência a carga)
	30 V CC 0,5 A (resistência a carga)
(Norma aplicável)	JNIOSH-TR-NO. 43(2008)

*A temperatura ambiente na certificação à prova de explosão é descrita acima e indica a faixa de temperatura que pode manter o desempenho à prova de explosão e não o desempenho do produto, ver '10-1. Lista de especificações' para detalhes.

Instalação

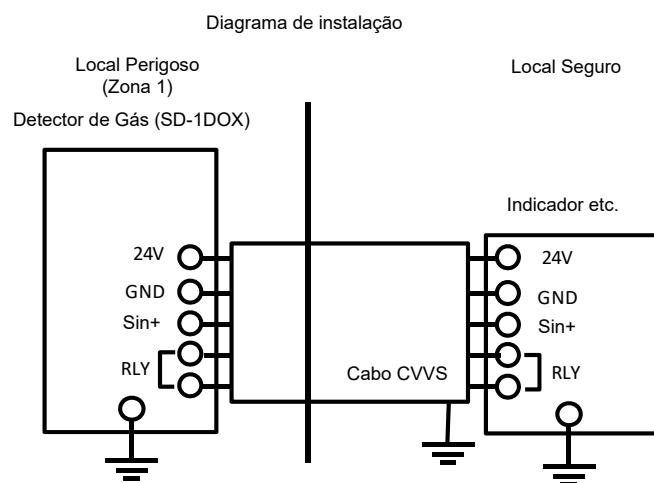


3


Componentes do produto

3-1. Unidade principal e acessórios padrão

<Unidade principal> (incluindo um bucim do cabo ou um adaptador)
 【Especificações ATEX/IECEX/INMETRO】

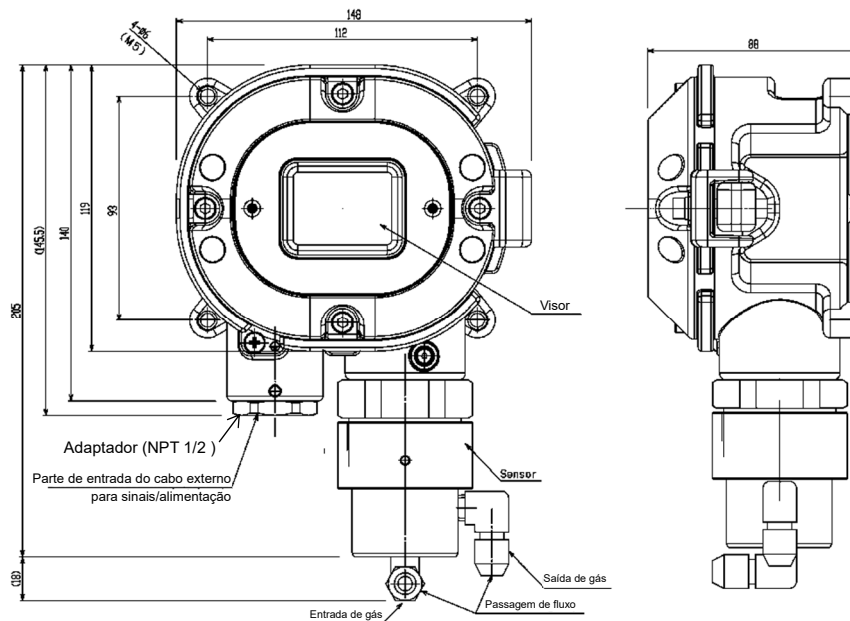

【Especificações Japan Ex】

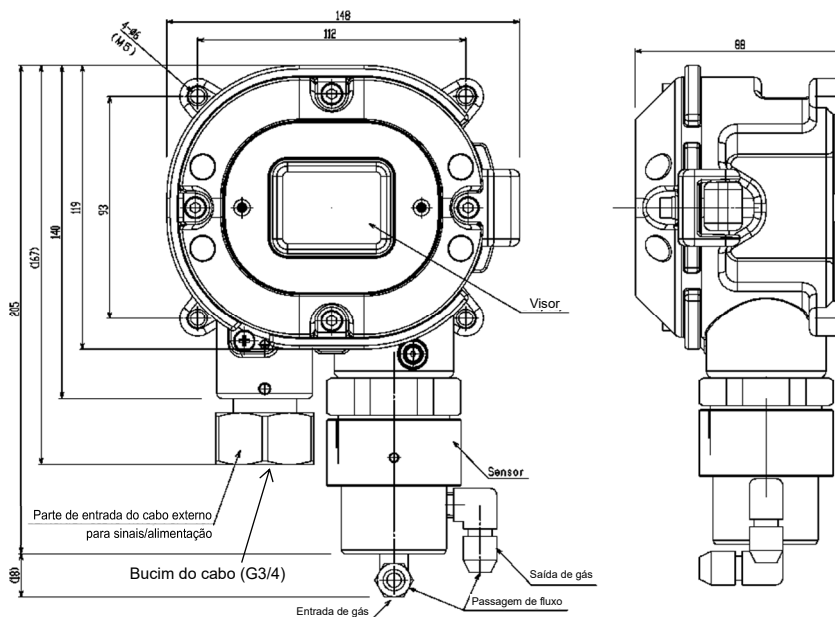

<Acessórios padrão>

Manual de instruções..... um

Alavanca de manuseamento específica (usada para a ligação) uma


Tecla de controle específica..... A quantidade fornecida depende do número de unidades a entregar.

1 - 10 unidades	uma
11 - 20 unidades	duas
21 - 50 unidades	três
Mais de 51 unidades	quatro

**CUIDADO**

Use a tecla de controle específica para operar o detector. Se utilizar outros produtos que não sejam os acessórios, as operações da tecla não podem ser aceitas adequadamente.


Observe que a chave de controle é feita de um ímã extremamente forte. Colocá-la próximo a um produto magnético, como um cartão de crédito e um cartão de identificação, pode danificar os dados armazenados.

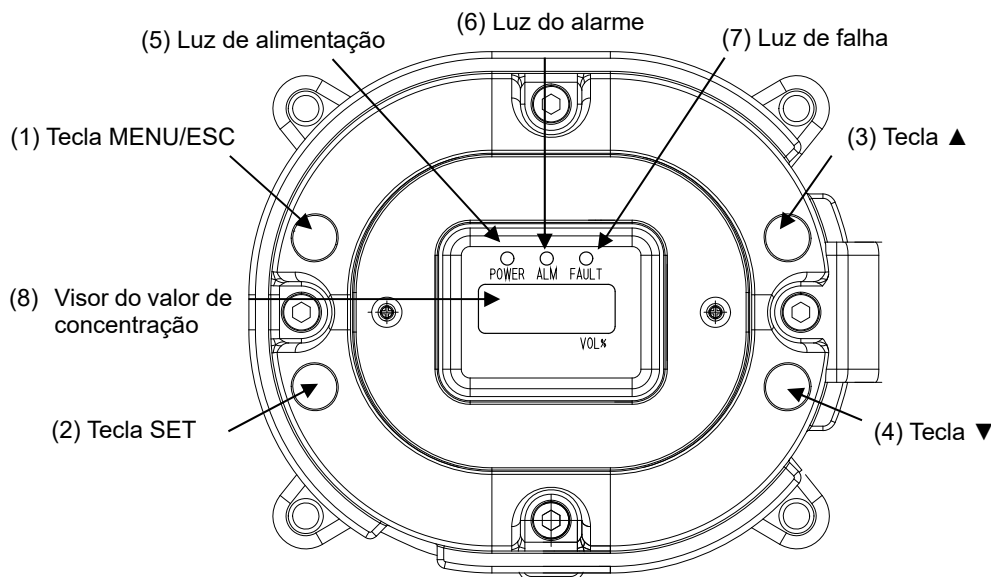3-2. Nomes e funções para cada peça

(1)	Tecla MENU/ESC	Usa-se para entrar no modo manutenção. Também se usa para cancelar um modo específico.
(2)	Tecla SET	Usa-se para confirmação do valor e assim por diante em um modo específico.
(3)	Tecla ▲	Usa-se para mudar de menus ou alterar um valor (PARA CIMA).
(4)	Tecla ▼	Usa-se para mudar de menus ou alterar um valor (PARA BAIXO).
(5)	Luz de alimentação	Luz de alimentação. Modo detecção: Acende em verde. Modo manutenção: Pisca em verde.
(6)	Luz do alarme	Luz do alarme. Acende em vermelho quando o valor de ponto de ajuste do alarme é atingido.
(7)	Luz de falha	Luz de falha. Acende a amarelo quando o detector detecta uma anomalia.
(8)	Visor do valor de concentração	Exibe a concentração de gás e assim por diante.

3-3. Diagrama do bloco

<Diagrama Elétrico>

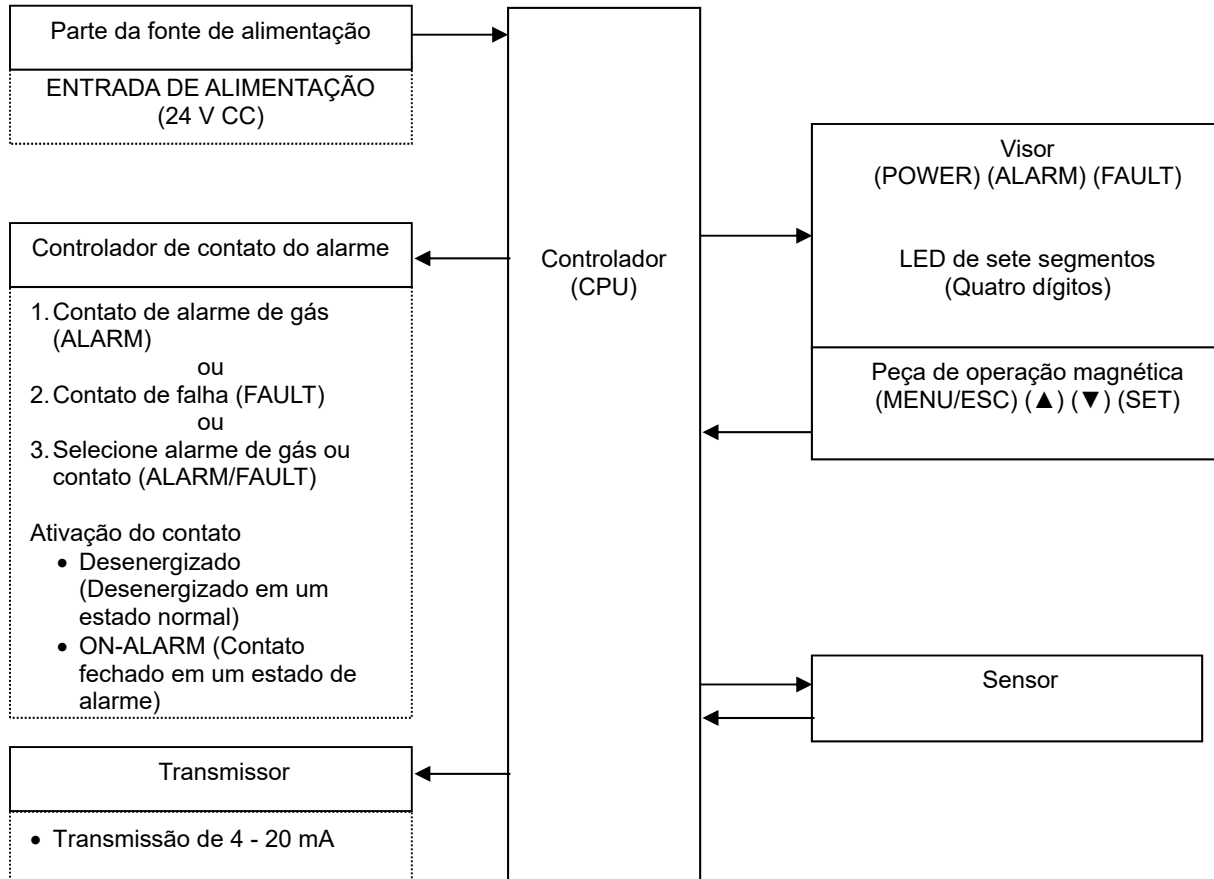

4

Como usar

4-1. Antes de utilizar o detector de gás

Não só os usuários iniciantes, mas também os usuários que já usaram o detector devem seguir as precauções de operação. Ignorar as precauções pode danificar o detector de gás e resultar em detecção incorreta do gás.

4-2. Precauções para locais de instalação



CUIDADO

Este é um dispositivo de precisão. Devido ao fato de o detector poder não fornecer o desempenho especificado em alguns locais (ambientes), verifique o ambiente no ponto de instalação e, em seguida, tome as ações adequadas se for necessário.

Uma vez que o detector desempenha um papel importante para a segurança e a prevenção de acidentes, tal como muitas unidades do detector têm de ser instaladas em pontos adequados à medida das necessidades.

Como os pontos onde os gases vazam e permanecem facilmente são diferentes dependendo dos tipos de gases e das áreas de trabalho, por favor, decida cuidadosamente sobre os pontos de instalação e o número de unidades a serem instaladas.

Não instale o detector em um local sujeito a vibrações ou choques.

O detector é composto por peças sensíveis. O detector tem de ser instalado em um local estável sem vibrações ou choques e não pode cair.

Não instale o detector em um local exposto a água, óleo ou químicos.

Quando selecionar pontos de instalação, evite um local onde o detector esteja exposto a água, óleo ou químicos.

Não instale o detector em um local onde a faixa de temperaturas de operação seja excedida.

O detector tem de ser instalado em um local estável onde a temperatura de operação seja mantida e não se altere subitamente.

<Especificações ATEX/IECEX/INMETRO> -10 - +40 °C

<Especificações Japan Ex> -10 - +40 °C

Não instale o detector em um local exposto à luz solar direta ou a alterações súbitas na temperatura.

Quando selecionar pontos de instalação, evite um local onde esteja exposto à luz solar direta ou a calor radiante (raios infravermelhos a partir de um objeto de alta temperatura) e onde a temperatura se altere subitamente. Pode formar-se condensação no interior do detector, ou o detector não consegue adaptar-se a alterações súbitas na temperatura.

Mantenha o detector (e seus cabos) longe de dispositivos fonte de ruído.

Quando selecionar pontos de instalação, evite um local onde existam dispositivos de alta voltagem/alta frequência.

Não instale o detector em um local onde não seja possível efetuar a manutenção do detector, ou onde o manuseio do detector envolva perigos.

É necessário efetuar a manutenção regular do detector.

Não instale o detector em um local onde seja necessário parar o maquinário para efetuar a manutenção em seu interior, onde seja necessário remover peças do maquinário para efetuar a manutenção, ou onde o detector não possa ser removido devido a tubos ou prateleiras que impeçam o acesso ao mesmo. Não instale o detector em um local onde a manutenção envolva perigos, por exemplo, perto de um cabo de alta voltagem.

Não instale o detector em maquinário que não esteja aterrado adequadamente.

Antes de instalar o detector no maquinário, o maquinário tem de ser aterrado adequadamente.

Não instale o detector em um local onde existam gases de interferência ao seu redor.

O detector não deve ser instalado em um local onde existam gases de interferência ao seu redor.



AVISO

Um detector de oxigênio é afetado pela pressão. Se o detector for usado a uma pressão diferente da pressão atmosférica, é necessária uma calibração sob essa pressão. A pressão máxima permitida é de 110 KPa. O detector não pode ser usado sob pressão reduzida. O uso do detector a uma pressão que exceda a faixa permissível pode causar problemas no desempenho do sensor de oxigênio.

4-3. Precauções para a concepção do sistema



CUIDADO

Uma fonte de alimentação instável e o ruído podem causar anomalias ou alarmes falsos. As descrições nesta seção têm defletir-se na concepção de um sistema usando um detector.

Usar uma fonte de alimentação externa

A saída externa e o alarme do contato do detector podem ser ativados quando se liga a alimentação, quando ocorre uma falha de energia temporária, ou enquanto o sistema está sendo estabilizado. Nesses casos, use um UPS (fonte de alimentação ininterrupta), ou tome as medidas apropriadas do lado do receptor.

O detector tem de ser fornecido com a fonte de alimentação seguinte:

Voltagem da fonte de alimentação	24 V CC \pm 10 %: Voltagem terminal do detector	
Tempo permitido para falha de energia temporária	Até 10 milissegundos (Para recuperar de uma falha de energia temporária durante 10 milissegundos ou mais, reinicie o detector.)	<u>Exemplo de ações</u> Para garantir o funcionamento contínuo e a ativação, instale uma UPS fora do detector.
Diversos	Não o use com uma fonte de alimentação: de carga de energia grande ou ruído de alta frequência.	<u>Exemplo de ações</u> Se necessário, use um filtro em linha para evitar a fonte ruído.

Introduzir medidas de proteção contra relâmpagos

Se os cabos estiverem instalados no interior da usina/fábrica, ou se os cabos internos estiverem instalados no mesmo duto que os cabos provenientes da usina/fábrica, os "relâmpagos" causarão problemas. Uma vez que os relâmpagos atuam como uma grande fonte de emissão enquanto os cabos atuam como uma antena receptora, os dispositivos conectados aos cabos podem ficar danificados.

Não é possível evitar os relâmpagos. Os cabos instalados em um conduíte metálico ou subterrâneos não podem estar totalmente protegidos contra picos de relâmpagos indutivos causados por relâmpagos.

Apesar de a eliminação completa de desastres causados por relâmpagos ser impossível, podem tomar-se as medidas de proteção seguintes.

Proteção contra relâmpagos	<p><u>Tome as medidas adequadas de acordo com a importância das instalações e o ambiente</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Forneça proteção por um pára-raios (retentor de cabos). (Embora o pico de relâmpagos indutivo possa ser transmitido através do cabo, pode evitar-se instalando um para-raios antes dos dispositivos de campo e do equipamento de processamento central. Para informações sobre como usar um para-raios, contacte o fabricante.)
Aterramento	Além dos relâmpagos existem mais fontes de ruído de pico. Para proteger a unidade contra estas fontes de ruído, as unidades têm que estar aterradas.

- * O pára-raios tem um circuito para remover uma voltagem pico que danifica os dispositivos de campo, para que os sinais possam ser atenuados. Antes de instalar um para-raios, verifique se funciona corretamente.

Uso adequado do contato de alarme

O contato do alarme do detector é usado para transmitir sinais para ativar uma buzina externa, uma lâmpada do alarme ou lâmpada rotativa. Não use o detector para fins de controle (por ex., controlar a válvula de seccionamento).

As especificações para o contato do alarme do detector baseiam-se nas condições de carga resistente. Se a carga indutiva for usada no contato do alarme, ocorrerão os erros seguintes facilmente porque se gera força eletromotora contra no contato.

- Deposição, isolamento defeituoso ou contato defeituoso no relé de contato.
- Danos de quaisquer peças elétricas devido a alta voltagem gerada dentro do detector.
- Operações anormais por uma CPU fora de controle.




CUIDADO

- A princípio, não ative a carga indutiva no alarme do contato do detector. (Em particular, nunca use a carga indutiva para ativar uma lâmpada fluorescente ou um motor.)
- Se a carga indutiva for ativada, apoie-a com um relé externo (amplificação de contato). No entanto, devido à bobina de um relé externo também envolver carga indutiva, selecione um relé de uma voltagem inferior (100 V CA ou menos) e, em seguida, proteja o contato de detector com uma peça de absorção de pico adequada, como um circuito CR.


Se for necessário ativar a carga, é necessário tomar medidas adequadas para estabilizar o funcionamento do detector e proteger o contato do alarme consultando as informações seguintes.

- Relé com um relé externo a uma voltagem inferior de 100 V CA ou menos (amplificação de contato). Simultaneamente, a parte de absorção de pico SK1 adequada para as especificações, tem de ser ligada ao relé externo.
- Além disso, a parte de absorção de pico SK2, se necessário, tem de ser ligada ao lado do relé externo.
- Recomenda-se que a parte de absorção deve ser ligada ao contato para determinadas condições de carga. Tem de ser ligada em uma posição adequada verificando como a carga é ativada.

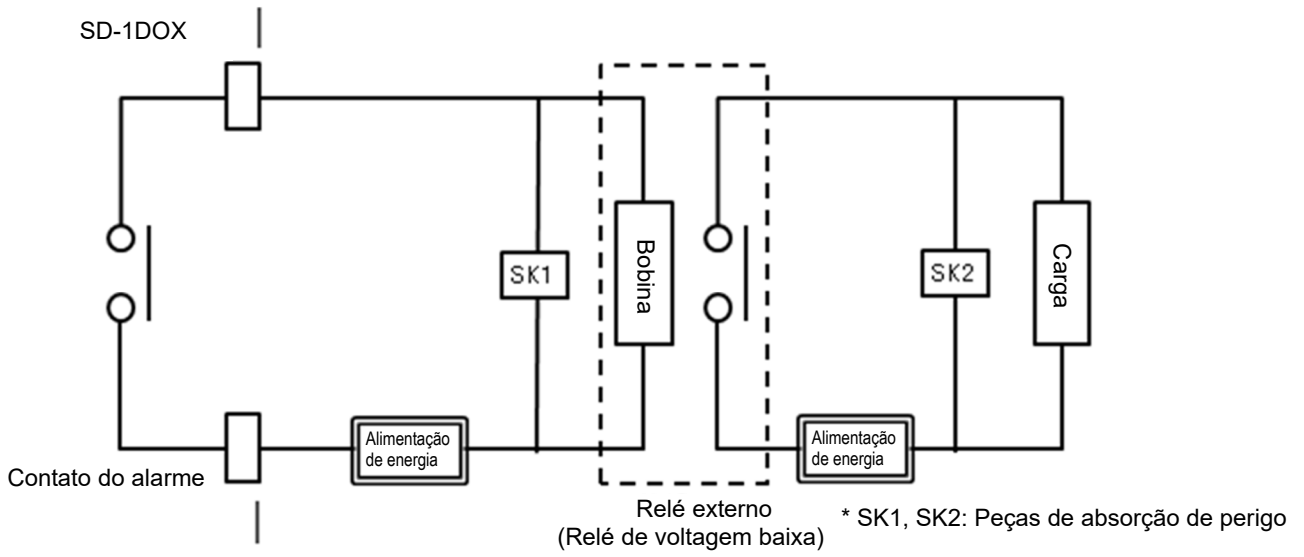

4-4. Como instalar

<Dimensões de instalação e espaço para a manutenção>

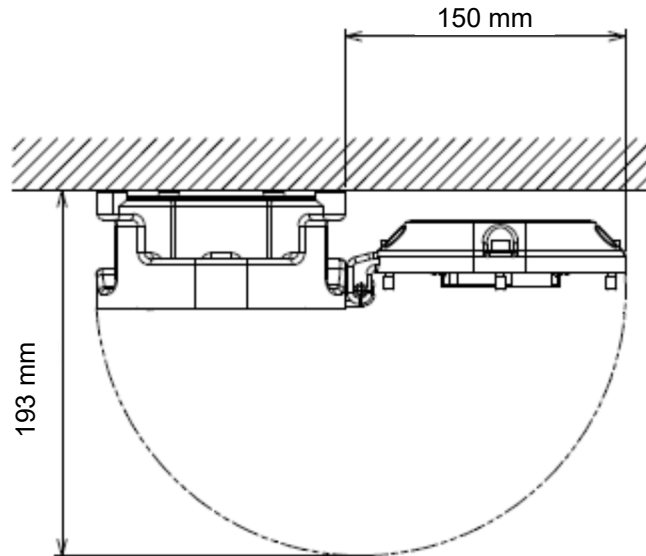

É necessário cumprir os seguintes requisitos de instalação para instalar o detector.

- Fixe o detector na parede ou outro local usando quatro parafusos M5.
- Aperte o parafuso de cabeça sextavada que fixa a tampa e o corpo principal com um torque de aperto de $215,6 \pm 24,5 \text{ N}\cdot\text{cm}$.
- Ao fechar a tampa do detector, certifique-se de que não haja pó no parafuso, superfícies do corpo principal e tampa. Em seguida, aplique graxa conforme especificado pela RIKEN KEIKI.



CUIDADO

Não instale o detector em um local onde não seja possível efetuar a manutenção do detector, ou onde o manuseio do detector envolva perigos.

É necessário efetuar a manutenção regular do detector.


Não instale o detector em um local onde seja necessário parar o maquinário para efetuar a manutenção em seu interior, onde seja necessário remover peças do maquinário para efetuar a manutenção, ou onde o detector não possa ser removido devido a tubos ou prateleiras que impeçam o acesso ao mesmo. Não instale o detector em um local onde a manutenção envolva perigos, por exemplo, perto de um cabo de alta voltagem.



AVISO

- Instale a cabeça detectora na direção especificada.
Instalar em uma direção errada pode causar leituras anormais.
- Instale o detector levando em devida consideração as condições para a área de detecção.
Normalmente, quando o detector é usado para detectar deficiência de oxigênio, a cabeça do detector deve ser instalada no nível da face.
- Quando houver risco de deficiência de oxigênio devido a um gás mais pesado que o ar (CO_2 , etc.), instale o detector levando em consideração a gravidade específica do gás.
- Não instale o detector em um local úmido onde ocorra condensação. Gotas de água formadas no sensor podem causar uma detecção anormal.

Direção de instalação da cabeça detetora

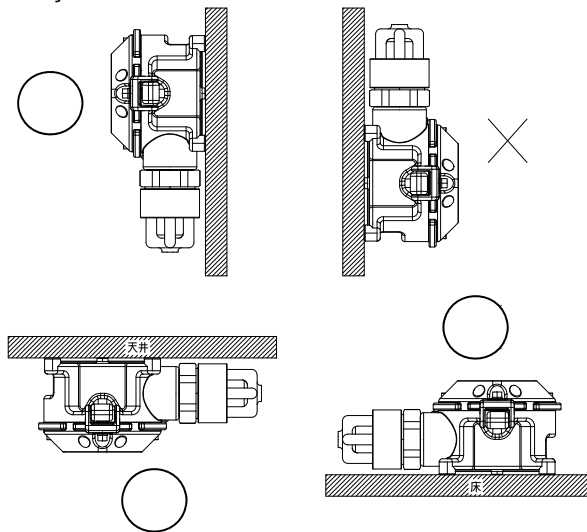

NOTA


- São utilizados parafusos de cabeça sextavada com classe de resistência "A2-70".
Quando o perder ou substituir um parafuso, recomendamos que pergunte ao nosso escritório de vendas local mais próximo.
- Graxa especificada pela RIKEN KEIKI : BARRIERTA JFE 552 (fabricada por NOK KLUBER)
Se não puder preparar a graxa especificada, use uma que atenda aos seguintes requisitos.
 1. O material não endurece devido à deterioração
 2. Livre de solventes voláteis
 3. O material não causa corrosão na superfície
 4. Sem silicone
 5. A validação da adequação depende das especificações do fabricante da graxa lubrificante

4-5. Procedimento de instalação

<Ligar um cabo externo>

【Especificações ATEX/IECEX/INMETRO】

A especificação ATEX / IECEX / INMETRO vem com adaptador A (NPT 1/2) como padrão. Prepare o buçim do cabo Ex que é adequado para o adaptador.




【Especificações Japan Ex】

Buçim do cabo, vedação de borracha, arruela e arruela excêntrica são montados no corpo principal no SD-1DOX, como mostrado abaixo.

Fixe as peças:

Passar um cabo (por exemplo, CVVS) através do buçim de cabo, arruela excêntrica, arruela e vedação de borracha, e puxe para dentro do detector. (Para métodos de arame, veja '4-6 Como ligar'). Ao instalar o buçim do cabo, certifique-se de que não haja poeira na peça de montagem do buçim, parafuso sextavado interno, parafuso de aterramento e buçim do cabo. Em seguida, aplique a graxa especificada pela RIKEN KEIKI.

Aperte o buçim do cabo e depois aperte o parafuso sextavado interno (M4 × 6), e fixe o buçim do cabo.

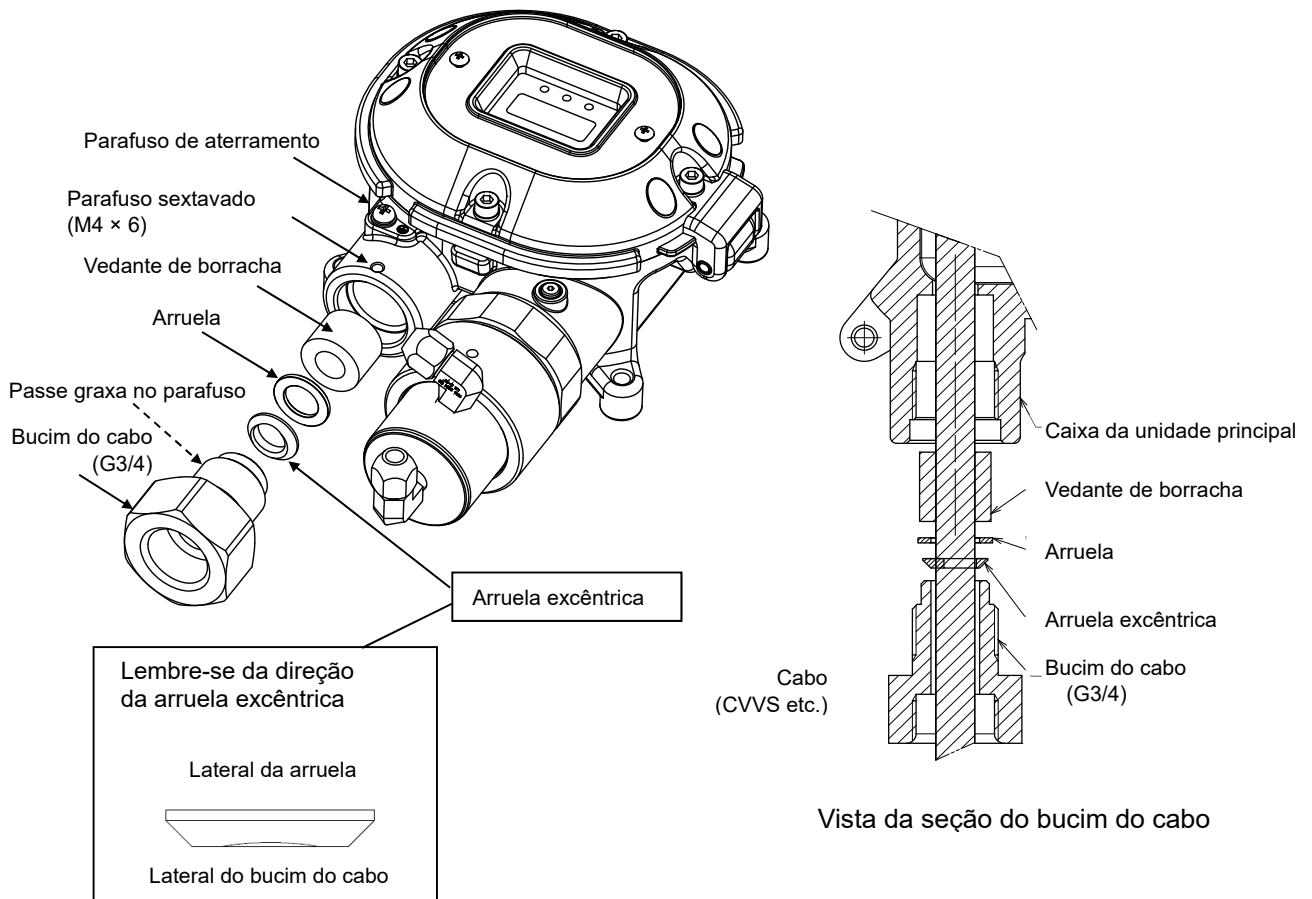

**AVISO**

- Não substitua peças a seu próprio critério, mas contacte a RIKEN KEIKI se o vidro transparente tiver uma fenda ou se a superfície de união da proteção contra explosão estiver anormal, ou o parafuso de fixação ou o parafuso se tiver alterado, perdido, etc.

**CUIDADO**

- Aperte 40 N·m ou maior valor de torque para garantir o aperto do bucim do cabo e tampão de vedação.
- Apertar os parafusos de cabeça sextavada que fixam o bucim do cabo com um torque de aperto de $107,8 \pm 12,7$ N·m.

NOTA

- Nossa graxa especificada pela empresa: BARRIERTA JFE 552 (fabricada por NOK KLUBER)
Se não puder preparar a graxa especificada, use uma que atenda aos seguintes requisitos.
 1. O material não endurece devido à deterioração
 2. Livre de solventes voláteis
 3. O material não causa corrosão na superfície
 4. Sem silicone
 5. A validação da adequação depende das especificações do fabricante da graxa lubrificante

4-6. Como ligar



CUIDADO


- Tenha cuidado para não danificar o circuito eletrônico interno quando ligar. Além disso, tenha cuidado para não aplicar forças no detector (excesso de peso) quando instalar os cabos.
- Os cabos de alimentação e os cabos de sinal não podem ser instalados juntamente com os cabos de alimentação do motor. Quando for necessário instalar os cabos por motivos inevitáveis, coloque os cabos de alimentação e os cabos de sinal em um circuito metálico. O conduto deve estar conectado a um circuito de aterramento.
- Quando se usam fios trançados, evite que os fios entrem em contato uns com os outros.
- Use uma alavanca de manuseio específica para ligar.
- Use cabos adequados para ligar.

<Cabos recomendados>

3 fios (quando o contato não for usado)	CVVS 1,25 mm ² ou 2,0 mm ² -3 núcleos
5 fios (quando o contato for usado)	CVVS 1,25 mm ² ou 2,0 mm ² -5 núcleos

<Tabela de comprimento de peças do cabo condutor exterior> (Especificações Japan Ex)


Diâmetro exterior da anilha (mm)	Diâmetro interno da anilha (mm)	Diâmetro interno da anilha (mm)	Diâmetro do grampo interno (mm)
Φ9,6 - Φ10,5	Φ11	Φ12	Φ10,8
Φ10,5 - Φ11,5	Φ12	Φ12	Φ11,8
Φ11,5 - Φ12,5	Φ13	Φ14	Φ12,8
Φ12,5 - Φ13,0	Φ13,5	Φ14	Φ13,8

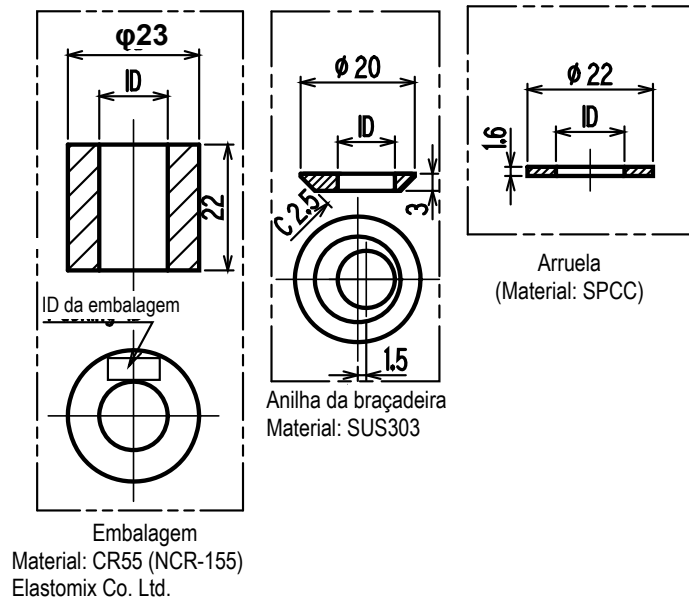


NOTA

- A tabela seguinte mostra um exemplo de diâmetros externos gerais dos cabos. Use-os como referência.
É necessário verificar os diâmetros externos gerais porque, às vezes, variam entre fabricantes.

Número de núcleo	CVV 1,25 mm ²	CVV 2 mm ²	CVVS 1,25 mm ²	CVVS 2 mm ²
2	ø9,5	ø10,5	ø10,0	ø11,0
3	ø10,0	ø11,0	ø10,5	ø11,5
4	ø10,5	ø11,5	ø11,0	ø12,0
5	ø11,5	ø12,5	ø12,0	ø13,0
6	ø12,5	ø13,5	ø13,0	ø14,0

Quando os quatro parafusos sextavados do cabeçote detector de gás "SD-1DOX" são desapertados e a tampa é aberta, aparece a seguinte placa terminal. São fornecidos terminais de aterramento : um interno e o outro externo.

<Figura da placa terminal>

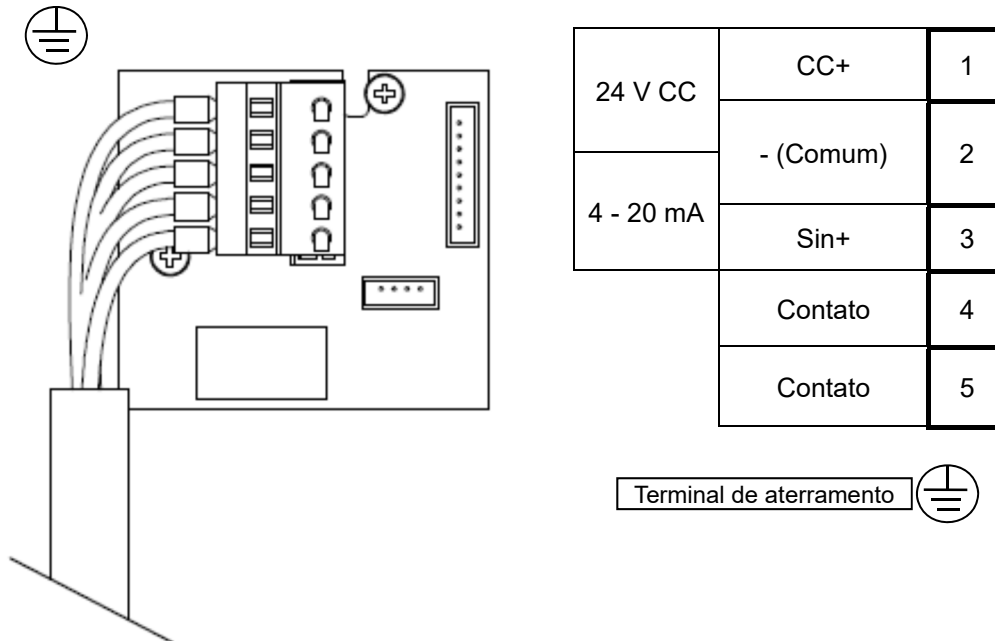

<Especificações da placa terminal>

Especificações da placa terminal

- Voltagem nominal: 250 V CA
- Corrente nominal: 12 A
No entanto, depende dos cabos a serem utilizados.

Condições de conexão

- Cabos: 0,25 - 2,5 mm²
- Comprimento do fio descarnado: 8 - 9 mm
- Ferramenta de conexão: Alavanca de manuseio específica (acessório) ou chave (extremidade 3,5 × 0,5 mm)

<Quando não é utilizada a saída de 4 - 20 mA>

Este detector tem uma função de autodiagnóstico que mostra E-9 no visor LED quando 4 - 20 mA não é emitido corretamente.

Se não for necessária uma saída de 4 - 20 mA, conectar a seguinte resistência fixa (tipo chumbo) aos terminais 2 e 3 ("Sin+" e "-(comum)").

Valor da resistência: 100 - 300 Ω Potência nominal: 0,25 W ou mais

Inserir um cabo e a resistência acima juntos no Terminal 2 (comum), e insira a parte do chumbo da resistência no terminal 3 (Sin+). Depois disso, verifique a imobilidade.



CUIDADO

É necessário respeitar o comprimento do fio descarnado especificado quando se remover o isolamento.

A fixação do fio inadequada devido a um comprimento do fio descarnado mais curto pode causar condução elétrica defeituosa ou aquecimento.

Prender o isolamento do fio devido a um comprimento do fio descarnado mais curto pode causar condução defeituosa ou aquecimento.

Expor o fio devido a um comprimento do fio descarnado mais comprido pode causar isolamento defeituoso ou um curto-circuito.

Tenha cuidado para não partir o fio. Se o fio se partir ao ser inserido no terminal, isso pode causar isolamento defeituoso ou aquecimento.



Terminal de barra compatível

Para um terminal de barra, estão disponíveis os itens seguintes.

- Terminal de barra (casquilho): Modelo Série 216 (fabricado pela WAGO)
- Ferramenta de engaste: Modelo VarioCrimp 4 (206-204) (fabricado pela WAGO)



CUIDADO

É necessário usar um terminal de barra do modelo especificado. Usar outros terminais de barra invalida a garantia do desempenho.

<Como conectar a placa terminal>

Quando os cabos estão conectados aos conectores, use a alavanca específica ou uma chave de fenda plana para proceder conforme mostrado abaixo.



CUIDADO

Devem ser usadas as ferramentas corretas.


Em princípio, pode-se conectar um fio a um orifício para cablagem.

Quando se insere o fio na ranhura da chave por engano, não entra em contato com a parte condutora. Isso pode causar condução elétrica defeituosa ou aquecimento.

Quando se insere o fio debaixo da mola por engano, não entra em contato com a parte condutora. Isso pode causar condução elétrica defeituosa ou aquecimento.

NOTA

<Como usar a alavanca de manuseio específica>

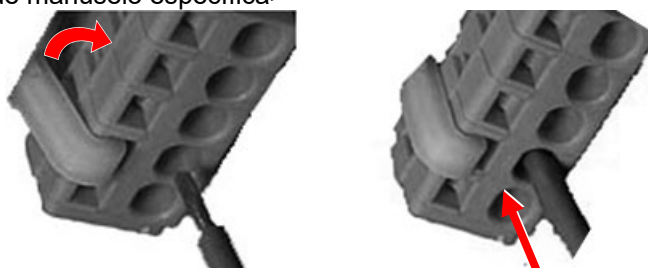

Empurre a alavanca com o seu dedo para baixar a mola para seu interior.

Mantendo a alavanca para baixo, insira o fio no orifício do fio (redondo) até que atinja o ponto mais profundo. Quando se libera a alavanca o fio é fixado.

Para verificar se o fio está conectado firmemente, puxe-o suavemente. (Não puxe o fio com força.)

<Aterramento>


Conecte o detector ao seu terminal de aterramento com o terminal externo

**AVISO**


- Antes de ligar o detector, não se esqueça de conectá-lo a um terminal de aterramento.
- Para o funcionamento e a segurança estáveis, tem de estar conectado a um terminal de aterramento. Não conecte o fio de aterramento a um tubo de gás.
- O aterramento tem de ser do tipo D (abaixo de 100 Ω de resistência de aterramento).
- Para o fio de aterramento, use terminais de condutor para conectar com segurança a um terminal de aterramento sem que fique frouxo ou torcido.
- Use terminais de anel para conectar o terminal de aterramento e use o fio de aterramento com área de seção transversal de 4 mm² ou mais para o terminal de aterramento externo.

<Exemplo de ligação>

Conectar ao indicador

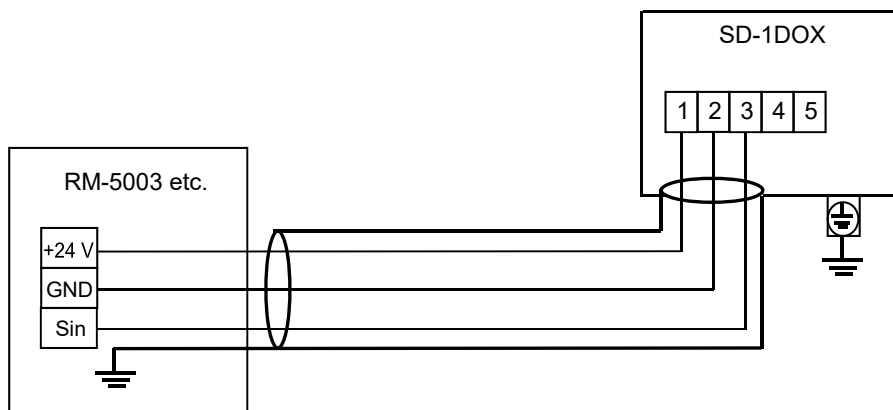

Conectar à unidade superior (DCS, PLC)

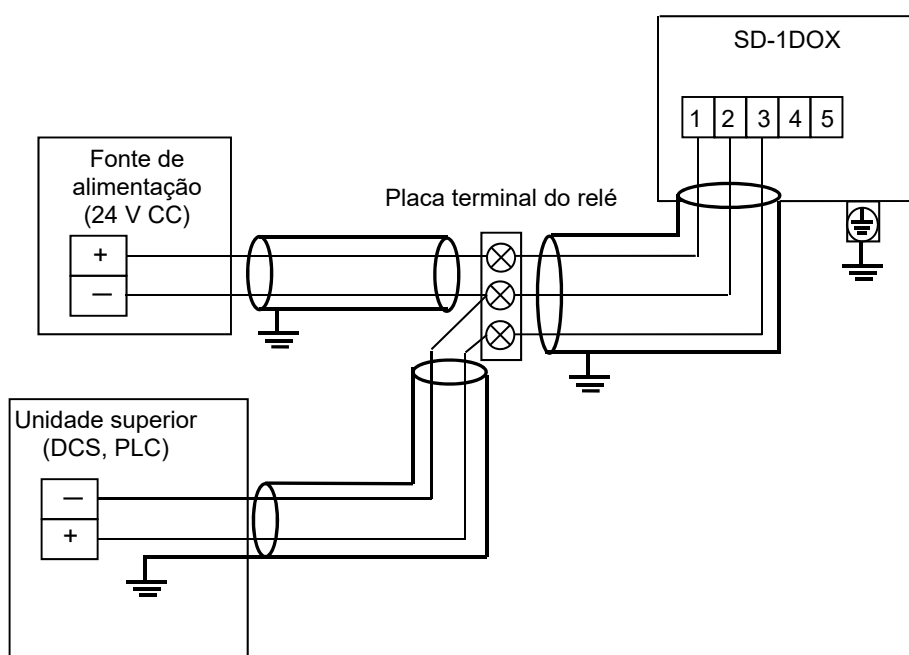

4-7. Como fazer a tubulação

O detector tem uma rosca Rc1/8 dentro da entrada/saída da amostra (GAS IN, GAS OUT), as uniões "PP" são normalmente fixadas. Como seu material varia de acordo com o gás a ser utilizado, favor especificar as uniões apropriadas.

O tubo compatível é um tubo de $\Phi 6$ (DE) - $\Phi 4$ (DI). O tubo deve ser instalado com as entradas e mangas fornecidas anexadas para evitar vazamentos.

Quando o tubo é cortado, seu ponto de corte tem um diâmetro interno menor. Use um arquivo etc. para expandir o diâmetro interno do ponto de corte. Para remover o pó cortado restante dentro do tubo, sopre ar comprimido para dentro do tubo antes de conectá-lo ao detector.

Algumas amostras de gases têm propriedades altamente adsorventes ou corrosivas. Selecione o material do tubo levando em conta estas precauções.

Tenha cuidado para que a vazão introduzida no detector esteja na faixa de 0,8 - 2 L/min (a pressão máxima dentro da trajetória da vazão e das peças do sensor é de 10,13 kPa <pressão de calibre>).



AVISO

- O detector está concebido para arrastar gases em torno do mesmo abaixo da pressão atmosférica. Certifique-se de que a pressão excessiva não seja aplicada à entrada e saída de amostragem (GAS IN, GAS OUT) do detector.
- Os gases detectados devem ser exauridos da saída de exaustão de gás detectado (GAS OUT) ao qual um tubo de exaustão está conectado, até um ponto considerado como um local seguro.



CUIDADO

- Quanto mais longo for o tubo do GAS IN, mais tempo leva para que um gás alcance o detector. Como alguns gases têm uma propriedade altamente adsorvente para o tubo, resultando em uma resposta lenta e uma leitura inferior ao valor real, o comprimento do tubo de GAS IN deve ser minimizado.
- Quando a umidade no ponto de amostragem é alta, a condensação pode ser formada no interior do tubo. Certifique-se de evitar a condensação ao utilizar um gás que é dissolvido em água e corrói materiais contatados, como um gás ácido forte, porque é indetectável e, além disso, pode corroer as partes internas. Evite também uma excessiva tubulação em forma de U ou de V.
- Determinar a entrada para a amostra de gás, considerando o fluxo de ar da linha de gás da amostra e o processo de geração de gás.
- Para remover o pó, não se esqueça de colocar um filtro de pó no meio do tubo.
- Você precisa decidir o comprimento e o material do tubo. Entre em contato com a RIKEN KEIKI para mais informações.

5

Como utilizar


5-1. Preparação para a partida

Antes de conectar uma fonte de alimentação, leia e compreenda as seguintes precauções. Ignorar estas precauções pode causar um choque elétrico ou danificar o detector.

- Conecte o detector a um circuito de aterramento.
- Verifique se os fios estão conectados corretamente ao dispositivo externo.
- Verifique se a voltagem da fonte de alimentação está em conformidade com as especificações.
- Devido ao fato de o contato externo poder ser ativado durante o ajuste, tome medidas para evitar que um contato ativado tenha interferências no dispositivo externo.
- Verifique se não há entupimento ou vazamento no tubo conectado. (Se o tubo conectado estiver entupido, a pressão é aplicada ao sensor, causando erros e mau funcionamento).
- Verifique se o filtro está corretamente fixado. (O filtro é especificado com base no gás a ser detectado).

5-2. Procedimentos de operação básicos

Normalmente, o modo detecção é usado para operações normais. (O modo detecção é ativado após ligar a alimentação.)

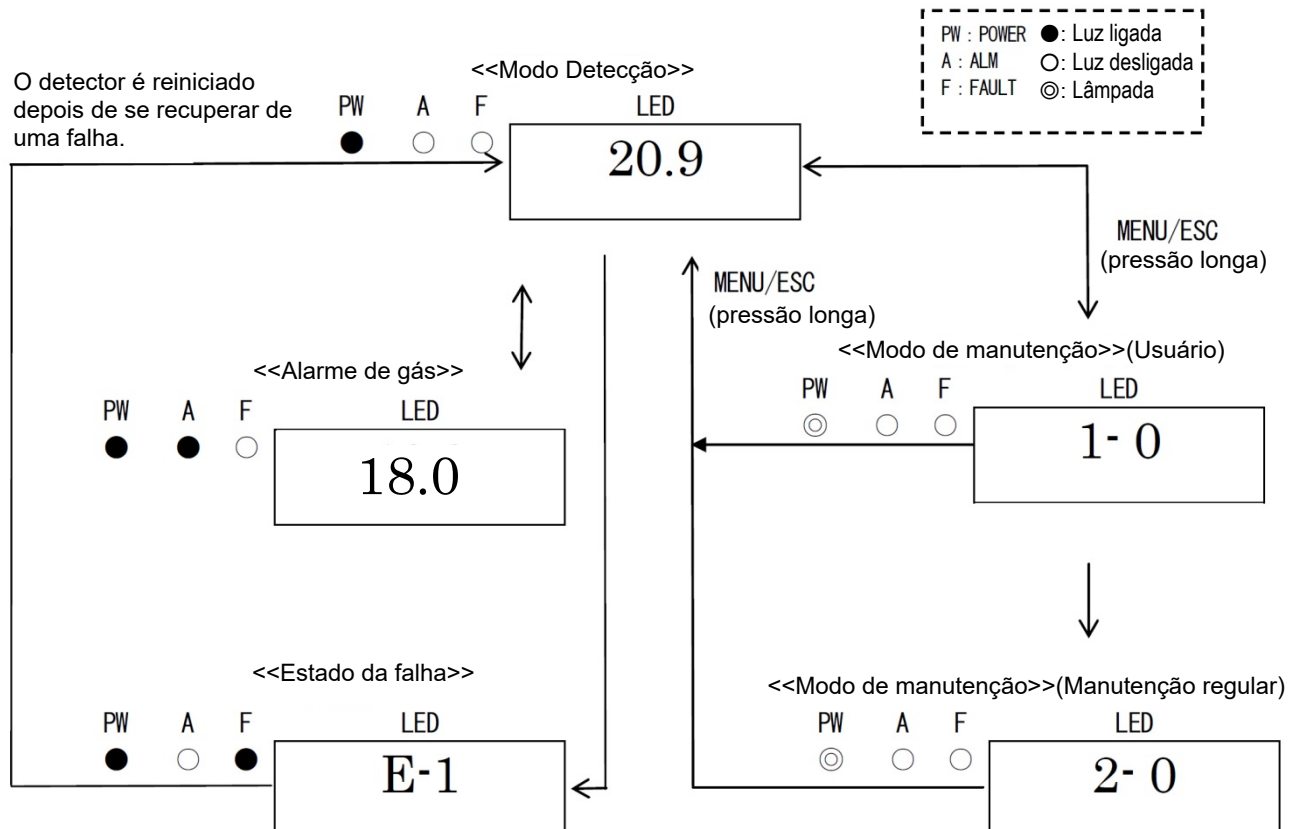



AVISO

Quando o detector entra em outro modo a partir do modo detecção enquanto o alarme é ativado, o alarme é reiniciado.

5-3. Como ligar o detector de gás

- Antes de fornecer alimentação (24 V CC) ao detector, verifique se o detector está instalado corretamente.
- Fonte de alimentação (24 V CC) para o detector (liga o detector).
- Após o detector concluir a partida, entra no modo detecção rapidamente.



CUIDADO


- Não desligue o conector durante o início. O detector está a ler a memória interna durante o início.
- Se o detector tiver sido instalado recentemente ou se se substituir o sensor, o sensor tem de ser aquecido durante um período especificado, que é determinado dependendo do tipo de sensor após o detector ter iniciado.
- Após a conclusão do aquecimento, realizar um ajuste da amplitude (ajuste AIR).

NOTA

<<Procedimentos da operação de partida>> (aproximadamente 25 segundos para o sistema verificar o detector e a desativação o alarme)

Alimentação ligada -> Ligação inicial (aproximadamente 25 segundos) -> Modo detecção

Alimentação Ligada

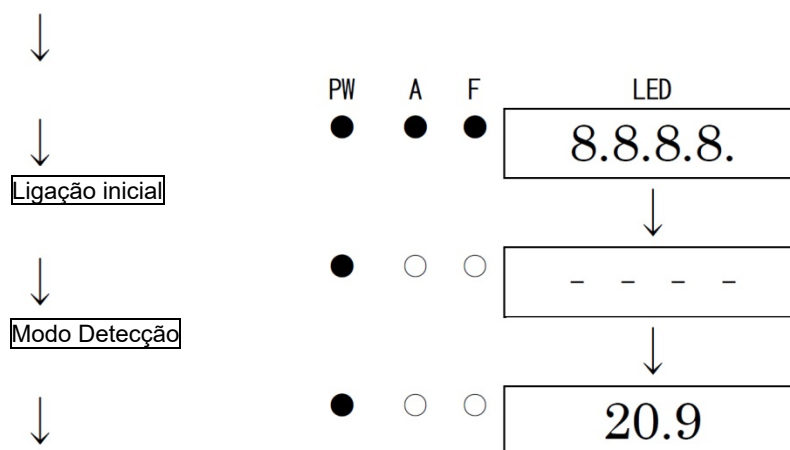

5-4. Modos

Os detalhes sobre cada modo são fornecidos conforme segue.



CUIDADO

- Não altere as definições se não for necessário. Alterar as definições sem compreender as especificações pode causar anomalias.

Modo	Item	Visor LED	Detalhes
Modo Detecção	-	Concentração de gás	Estado normal
Modo manutenção (Usuário)	Visor ROM/SUM	1-0	Exibe a versão do programa e diversos. Tipicamente não é usado pelo usuário.
	Ajuste de amplitude (ajuste AIR)	1-1	Realiza o ajuste de amplitude (ajuste AIR).
	Visor de definições	1-2	Exibe vários valores de definição.
	Muda para o modo manutenção.	1-3	Muda para o manutenção regular.
Modo manutenção (Manutenção regular)	Modo teste	2-0	Efetua vários testes. 2-0.0 Teste de gás 2-0.1 Teste do alarme 2-0.2 Teste de falha 2-0.3 Teste do LED 2-0.4 Teste da memória
	Ajuste zero (ajuste N ₂)	2-1	Efetue o ajuste zero (ajuste N ₂).
	Ajuste de amplitude (ajuste AIR)	2-2	Realiza o ajuste de amplitude (ajuste AIR).
	Inicialização amplitude/zero	2-3	Inicializa os valores de amplitude/zero.
	Definição ambiental	2-4	Usa-se para várias definições ambientais. 2-4.0 LIGAR/DESLIGAR a fonte de alimentação do sensor 2-4.1 Definição INHIBIT 2-4.2 Configuração do ponto de ajuste do alarme 2-4.3 Definição do tempo de atraso de alarme 2-4.4 Padrão de configuração do alarme 2-4.5 Configuração de tipo de supressão 2-4.6 Configuração de valor de supressão 2-4.7 Configuração de especificação de contato de alarme 2-4.8 configuração de contato desenergizado/energizado 2-4.9 Não utilizado. 2-4.A Configuração de saída externa do modo manutenção 2-4.B Ajuste de saída externa 2-4.C Configuração de saída de teste do alarme 2-4.D Não utilizado. 2-4.E Configuração da senha 2-4.F Configuração do padrão do alarme de falha
	Visor	2-5	Exibe várias configurações elétricas. Tipicamente não é usado pelo usuário.
	Muda para o modo usina	2-6	Não usado.
	Muda para o modo usuário	2-7	Retorna ao modo usuário.


5-5. Modo de manutenção (Usuário)



AVISO


Após a conclusão do ajuste, nunca deixe de pressionar a tecla MENU/ESC para retornar ao modo detecção.

(Se o detector permanecer no modo usuário, retorna automaticamente ao modo detecção no espaço de dez horas.)

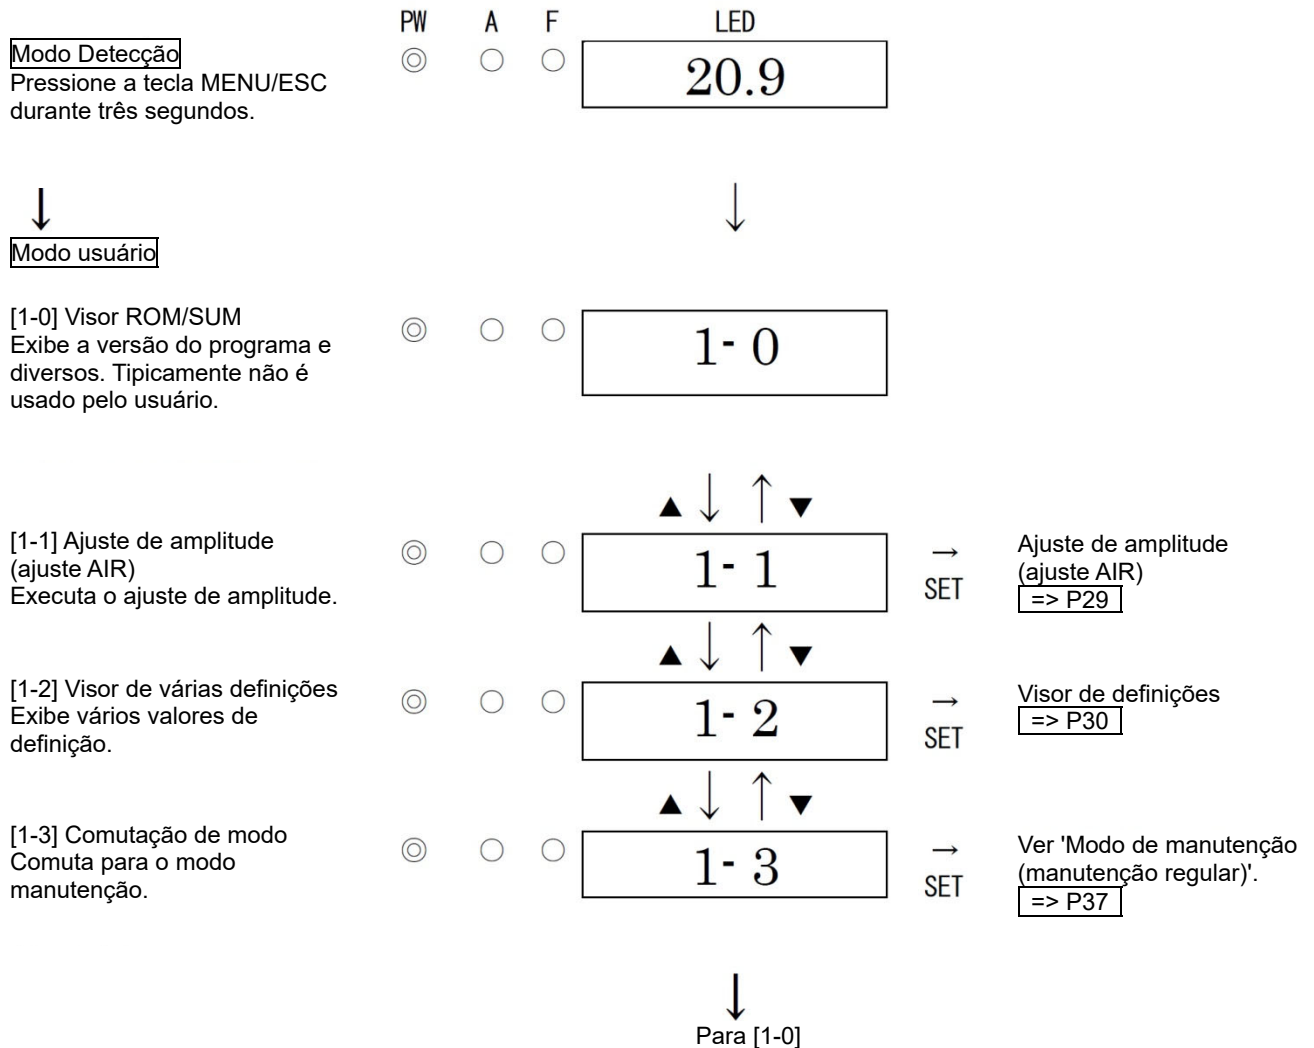

<Ajuste de amplitude (ajuste de AIR) [1-1]>


É utilizado para realizar o ajuste zero (ajuste AIR).

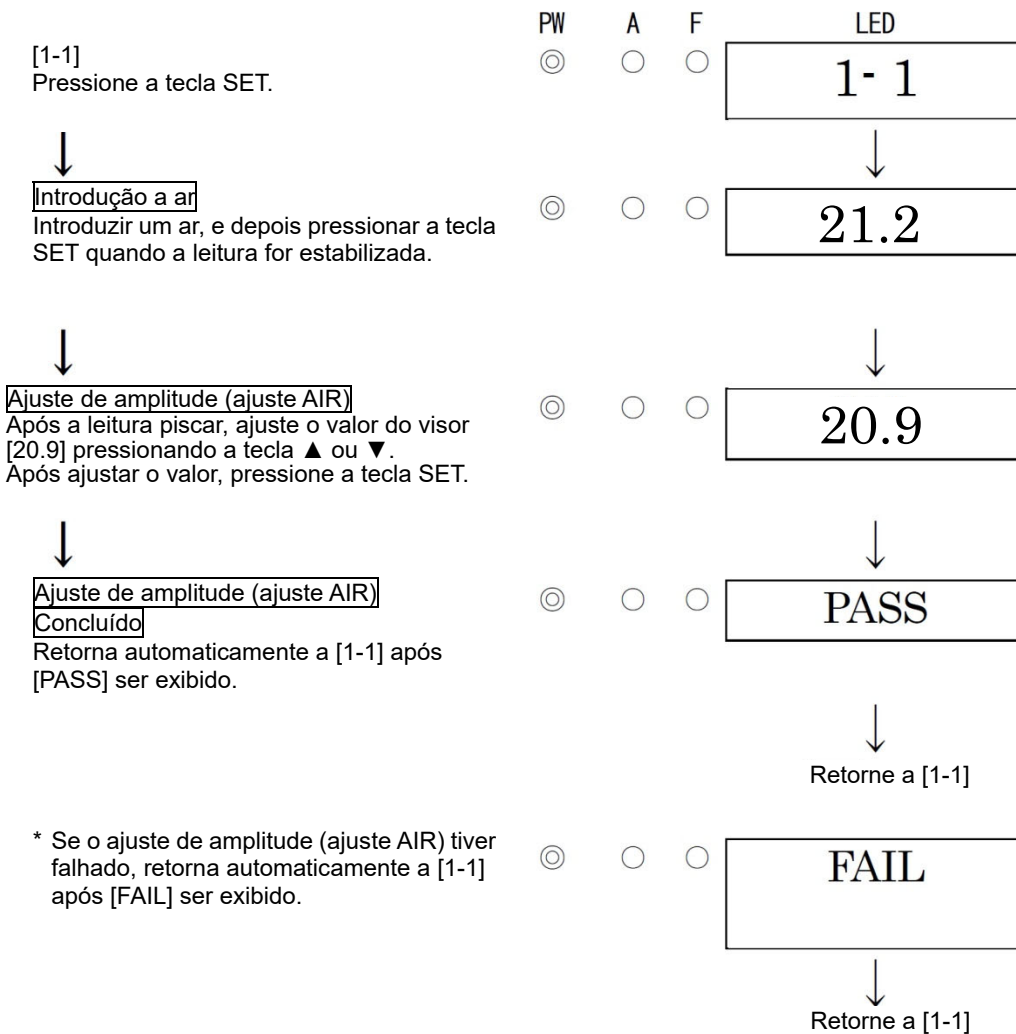**NOTA**

- Se o ajuste da amplitude (ajuste AIR) falhou, uma vez que o ponto de amplitude oscilou significativamente de cerca de 20,9 %, ele retorna para [1-1] após a exibição de [FAIL] em vez de [PASS]. Neste caso, o ajuste da amplitude (ajuste AIR) ainda não foi concluído.

<Exibição da definição [1-2]>

Exibe vários valores de definição.

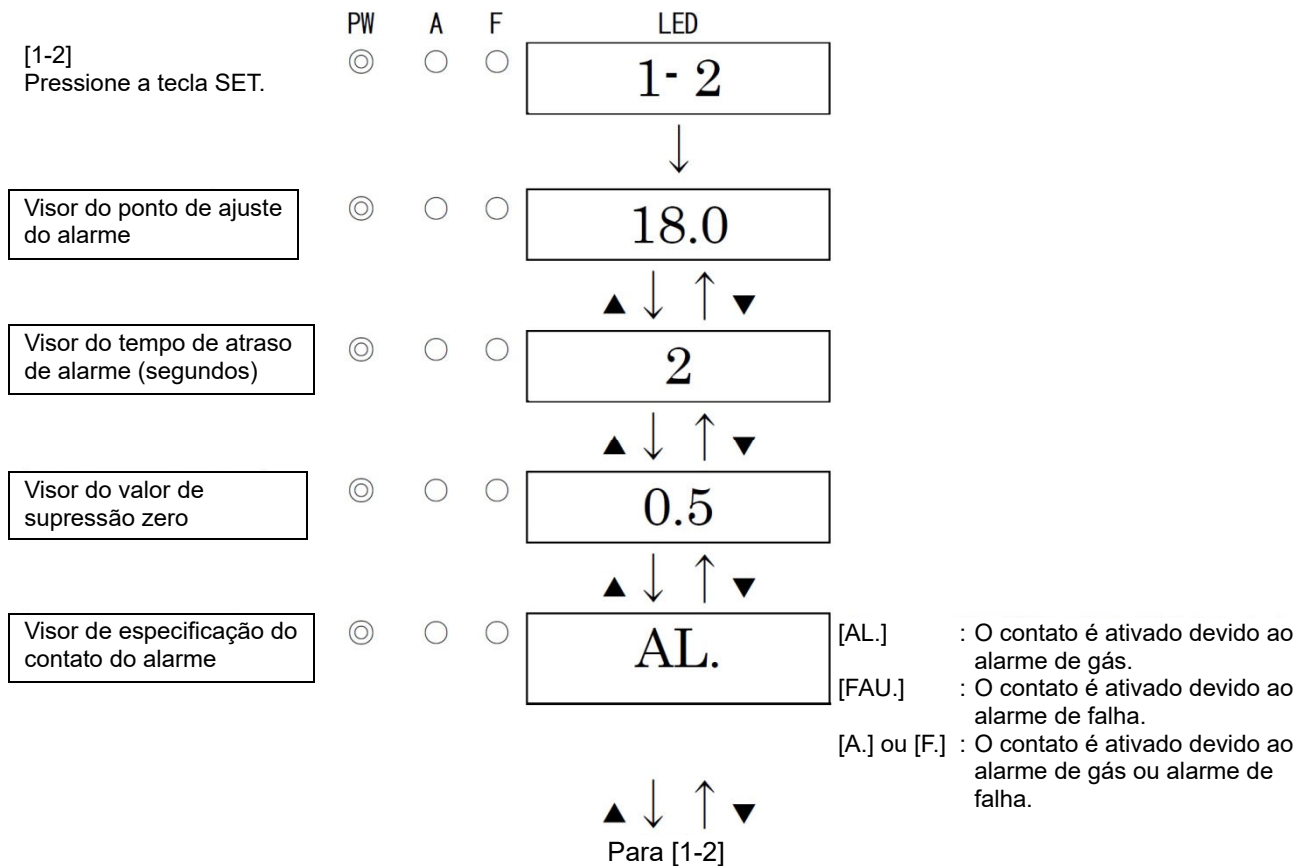

5-6. Como sair

Para desligar o detector, desligue a fonte de alimentação (24 V CC) no detector.



AVISO

- Quando se desliga o detector, pode disparar um alarme no sistema (central) superior.
- Antes de desligar o detector, o sistema INHIBIT (avançar ponto) no sistema superior (central) tem de ser ativado. Decida se a alimentação pode ser desligada verificando o funcionamento dos dispositivos conectados à saída externa ou ao terminal de saída de contato externo do detector.
- Se o contato do alarme estiver energizado (opção), é ativado quando o detector está "DESLIGADO".

6

Operações e funções

6-1. Ativação do alarme

Alarme de concentração de oxigênio: Ativado quando a concentração de oxigênio detectada atinge ou excede o valor do ponto de ajuste do alarme. <<Operação de reinicialização automática>>

NOTA

O ponto de ajuste do alarme está definido de fábrica. Apesar do tempo de atraso de alarme (padrão: 2 segundos) funciona no detector para evitar uma ativação falsa e pode cancelar-se se não for necessário.

<Operação do visor>

Visor de concentração de oxigênio

Em caso de acima da faixa de detecção exibe-se (Over Scale), [∩∩∩∩] no LED.

Luz indicadora de alimentação (POWER: verde)

Durante o funcionamento, esta acende continuamente.


Luz indicadora de alarme (ALM: vermelha)

Acende quando o valor de ponto de ajuste do alarme é atingido ou excedido.

<Ativação do contato>

O contato é ativado quando a concentração de oxigênio atinge ou excede o valor do ponto de ajuste do alarme (somente quando o alarme é usado).

A ativação do contato é reinicializada automaticamente quando a concentração de gás desce abaixo do valor do ponto de ajuste do alarme.

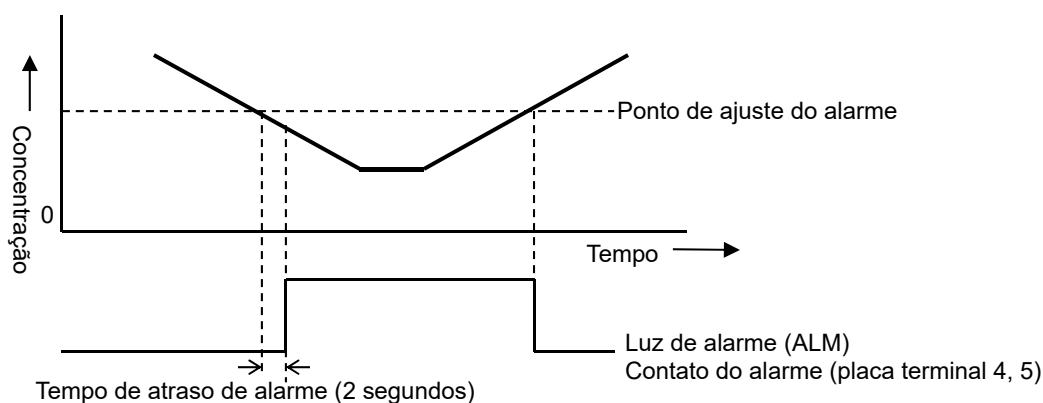

<Resposta ao Alarme>

Um valor de concentração de oxigênio excede o ponto de ajuste de alarme

Quando um alarme é acionado, tome ações de acordo com suas regras de gestão de alarme. Normalmente, tome as ações seguintes.

- Verifique a leitura do detector.

NOTA

Se um vazamento de gás for temporário, a leitura poderá já ter descido ao verificá-lo. Além disso, quando um alarme dispara devido a ruído ou outras condições incidentais que não sejam um gás, a leitura poderá já ter descido.

- Com base em suas regras de gerenciamento de alarme de gás, ninguém está autorizado a acessar à zona monitorada para garantir a segurança.
- Se o visor de concentração do gás continuar a ser exibido, feche a válvula do gás principal e, em seguida, verifique se a leitura da concentração de gás desceu.
- Acesse ao ponto de vazamento de gás, equipado com uma engrenagem protetora para evitar perigos causados pela probabilidade de gases remanescentes e verifique se os gases permanecem ou não usando um detector de gás portátil.
- Verifique se o ponto está livre de perigos e tome ações para corrigir o vazamento de gás.

6-2. Ativação do alarme de falha

É disparado um alarme quando o detector detecta anomalias. Após um alarme de falha ter disparado, a luz de falha (amarela) acende e exibe-se uma mensagem de erro no LED. Determine as causas e tome as ações adequadas.

Após o detector ter retornado com sucesso da falha, reinicia com o processo executado normalmente logo após ter sido ligado (ligação inicial).

Se o detector tiver problemas e funcionar mal repetidamente, contate imediatamente a RIKEN KEIKI.

<Operação do visor>

Visor de detalhes de falhas

Exibe uma mensagem a indicar os detalhes da falha.

Luz de falha (FAULT: amarela)

Acende quando ocorre uma falha.

NOTA

Para mais informações sobre anomalias (mensagens de erro), consulte '9. Resolução de problemas'.


6-3. Operação de saída externa

0 - 25 vol% (Especificação do alarme de deficiência de oxigênio)

Sistema de transmissão de sinal		Transmissão de corrente elétrica (não isolada) 4 - 20 mA
Caminho de transmissão		Equivalente CVVS
Distância de transmissão		Equivalente CVVS 1,25 mm ² : Máximo 1,25 km Equivalente CVVS 2,0 mm ² : Máximo 2,0 km
Resistência de carga de conexão		Abaixo de 300 Ω
1	Modo de detecção (sem alarme)	4 - 20 mA (saída de concentração)
2	Modo de detecção (alarme de gás)	4 - 20 mA (saída de concentração)
3	Ligação inicial	Dependendo da definição da seção 4. Definição 2,5 mA: 2,5 mA 4 mA, HOLD, definição 4 - 20 mA: Equivalente ao valor AIR (17,4 mA)
4	Modo manutenção	Definição 2,5 mA: 2,5 mA Definição 4 mA: Equivalente ao valor AIR (17,4 mA) Definição de HOLD: O valor anterior retido Definição 4 - 20 mA: 4 - 20 mA (saída de concentração)
5	Teste do alarme	Definição LIGADA saída: 4 - 20 mA (saída de concentração) Definição DESLIGADA saída: O valor anterior retido
6	Alarme de falha	0,5 mA (Fixo)
7	INHIBIT	Dependendo da definição da seção 4. Definição 2,5 mA: 2,5 mA 4 mA, HOLD, definição 4 - 20 mA: Equivalente ao valor AIR (17,4 mA)
8	Alimentação desligada	0 mA

Exemplo de concentração de gás e saída externa

0 - 25 vol% (Especificação do alarme de deficiência de oxigênio)

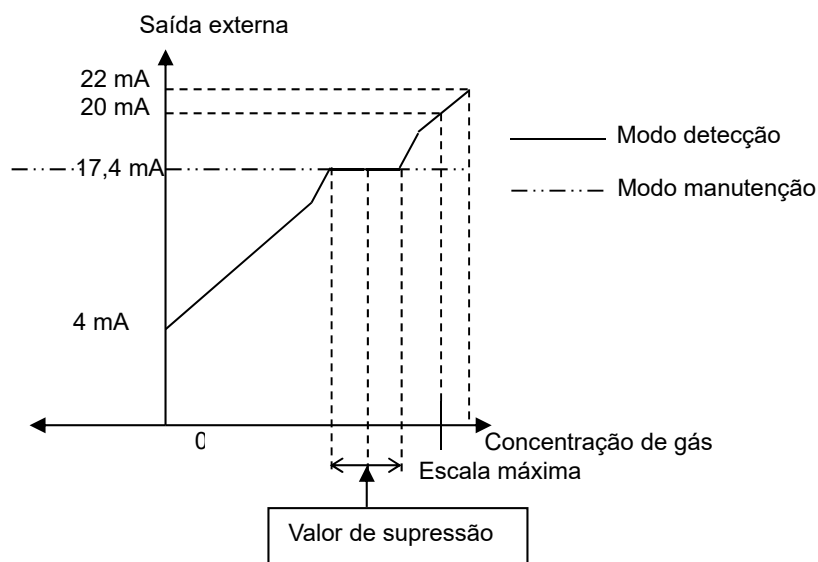

CAUIDADO


- A saída de 4 - 20 mA já está ajustada. No caso de escala em excesso, uma saída não ultrapassará 22 mA.
- A saída durante a INHIBIT ou ligação inicial baseia-se na definição de saída de 4 - 20 mA no modo manutenção.
Em particular, quando o detector é iniciado ou se altera a especificação, tenha cuidado com a definição da saída de cerca de 4-20 mA. Compreenda como o detector funciona e, se necessário, tome ações para que o lado do receptor de sinal possa preparar-se para evitar alarmes falsos.

6-4. Outras funções

<Função supressão>

Os sensores usados com o detector são influenciados por mudanças ambientais (temperatura, umidade e outras características) em grande medida, o que afeta a leitura. Portanto, a leitura pode ser flutuante mesmo em um ambiente normal.

Esta função obscurece as influências por mudanças ambientais ou outros fatores que não têm significado para suas regras de gestão de alarme. Esta função é usada para ocultar (suprimir) a flutuação da leitura sob o valor de ajuste, indicando 20,9 vol%.

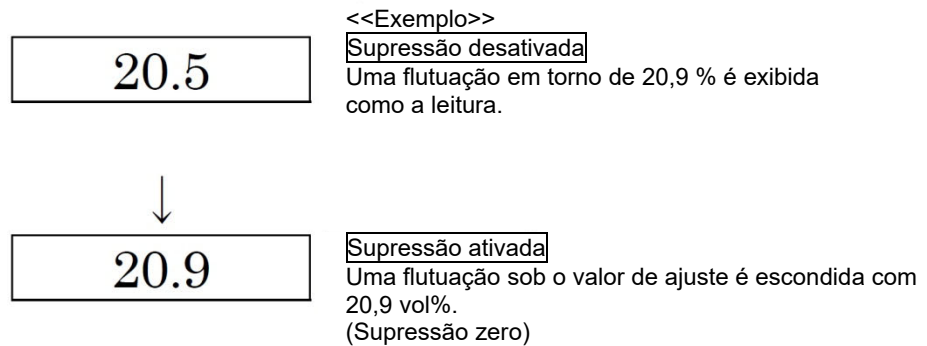

NOTA

- A função supressão está definida de fábrica. O valor de ajuste padrão é de $\pm 0,5$ vol% (para 20,9 vol%).
- No modo de manutenção (<Usuário> ou <Manutenção regular>), esta função é desativada e a flutuação da leitura sob o valor de ajuste é exibida.



CUIDADO

Uma leitura abaixo de zero é suprimida com a supressão 10 % FS.

Uma leitura que chega a 10 % FS ou mais abaixo de zero é exibida como [-0.0], o que impede uma detecção de gás de precisão e necessita de ajuste zero.

7

Manutenção

O detector de gás é um instrumento importante para fins de segurança.

Para manter o desempenho do detector de gás e melhorar a confiabilidade da segurança, execute uma manutenção regular.

7-1. Intervalos e itens de manutenção

- Manutenção diária: Execute a manutenção antes de começar a trabalhar.
- Manutenção mensal: Execute a manutenção no circuito do alarme (teste do alarme) uma vez por mês.
- Manutenção regular: Execute a manutenção uma vez ou mais a cada seis meses para manter o desempenho como uma unidade de segurança.

Item de manutenção	Conteúdo da manutenção	Manutenção diária	Manutenção mensal	Manutenção regular
Verificação da fonte de alimentação	Verifique se a luz de alimentação acende.	○	○	○
Verificação do visor de concentração	Verifique se o valor do visor de concentração é zero (ou 20,9 vol % no medidor de oxigênio). Quando a leitura estiver incorreta, executar o ajuste de zero (ou ajuste de amplitude) após assegurar-se de que não haja gases de interferência ao seu redor.	○	○	○
Verificar a taxa de fluxo	Verificar a taxa de fluxo para encontrar anormalidades.	○	○	○
Verificação do filtro	Verifique o filtro do pó relativamente a poeira ou entupimento.	○	○	○
Teste do alarme	Inspeccione o circuito do alarme usando a função teste do alarme.	—	○	○
Ajuste de amplitude	Realize o ajuste de amplitude usando o gás de calibração.	—	—	○
Verificação do alarme de gás	Verifique o alarme de gás usando o gás de calibração.	—	—	○

<Sobre os Serviços de Manutenção>

- Fornecemos serviços de manutenção regular, incluindo ajuste de amplitude, outros ajustes e manutenção.
Para efetuar a calibração do gás, são necessárias ferramentas específicas, tais como uma botija de gás de concentração e do saco de amostragem de gás especificados.
Nossos engenheiros de serviço qualificados têm especialização e conhecimento das ferramentas específicas usadas para serviços, juntamente com outros produtos. Para manter o funcionamento em segurança do detector, use nosso serviço de manutenção.
- Os seguintes são serviços de manutenção típicos. Para mais informações, entre em contato com a RIKEN KEIKI.

Serviços principais

- Verificação da fonte de alimentação : Verifica a voltagem da fonte de alimentação.
Verifica se a luz de alimentação acende.
(Verifica se os pontos relevantes podem ser identificados no sistema.)
(Quando é usada uma UPS (sistema de alimentação ininterrupta), verifica a operação com a UPS.)
- Verificação do visor de concentração : Verifica se o valor do visor de concentração é zero (ou 20,9 vol% no medidor de deficiência de oxigênio) usando o gás zero.
Executa o ajuste zero (ajuste do ar fresco) se a leitura for incorreta.
- Verificar a taxa de fluxo : Verifica o indicador de taxa de fluxo para procurar anomalias.
Verifica a taxa de fluxo usando um medidor de fluxo externo para verificar a precisão do indicador de taxa de fluxo no detector de gás. Se a taxa de fluxo estiver incorreta, executa o ajuste da taxa de fluxo.
- Verificação do filtro : Verifica o filtro do pó relativamente a poeira ou entupimento.
Substitui um filtro do sujo ou entupido.
- Teste do alarme : Inspecciona o circuito do alarme usando a função teste do alarme.
 - Verifica as luzes do alarme. (Verifica a ativação do ALM1).
 - Verifica o alarme externo. (Verifica a ativação do alarme externo, como uma buzina.)
- Ajuste de amplitude : Realiza o ajuste de amplitude usando o gás de calibração.
- Verificação do alarme de gás : Verifica o alarme de gás usando o gás de calibração.
 - Verifica o alarme. (Verifica o acionamento do alarme quando o ponto de ajuste do alarme é atingido.)
 - Verifica o tempo de atraso. (Verifica o tempo de atraso até que o alarme seja disparado.)
 - Verifica as luzes do alarme. (Verifica a ativação do ALM1).
 - Verifica o alarme externo. (Verifica a ativação de alarmes externos, tais como uma buzina ou um sinal de reinicialização.)
- Limpeza e reparo do dispositivo (Diagnóstico visual) : Verifique se existe pó ou danos na superfície, na tampa ou nas peças internas do detector.
Limpe e repare tais peças do detector.
Substitua as peças que estejam rachadas ou danificadas.
- Verificação de operação do dispositivo : Use as teclas para verificar o funcionamento de funções e parâmetros.
- Substituição de peças consumíveis : Substitua as peças consumíveis, tais como um sensor, o filtro e a bomba.


7-2. Modo de manutenção (manutenção regular)



AVISO


Após a conclusão do ajuste, nunca deixe de pressionar a tecla MENU/ESC para retornar ao modo detecção.
 (Se o detector permanecer no modo manutenção regular, retorna automaticamente ao modo detecção no espaço de dez horas.)

Modo	Item	Visor LED	Detalhes
Modo manutenção (Manutenção regular)	Modo teste	2-0	Efetua vários testes. 2-0.0 Teste de gás 2-0.1 Teste do alarme 2-0.2 Teste de falha 2-0.3 Teste do LED 2-0.4 Teste da memória
	Ajuste zero (ajuste N ₂)	2-1	Efetue o ajuste zero (ajuste N ₂).
	Ajuste de amplitude (ajuste AIR)	2-2	Realiza o ajuste de amplitude (ajuste AIR).
	Inicialização amplitude/zero	2-3	Inicializa os valores de amplitude/zero.
	Definição ambiental	2-4	Usa-se para várias definições ambientais. 2-4.0 LIGAR/DESLIGAR a fonte de alimentação do sensor 2-4.1 Definição INHIBIT 2-4.2 Configuração do ponto de ajuste do alarme 2-4.3 Definição do tempo de atraso de alarme 2-4.4 Padrão de configuração do alarme 2-4.5 Configuração de tipo de supressão 2-4.6 Configuração de valor de supressão 2-4.7 Configuração de especificação de contato de alarme 2-4.8 configuração de contato desenergizado/energizado 2-4.9 Não utilizado. 2-4.A Configuração de saída externa do modo manutenção 2-4.B Ajuste de saída externa 2-4.C Configuração de saída de teste do alarme 2-4.D Não utilizado. 2-4.E Configuração da senha 2-4.F Configuração do padrão do alarme de falha
	Visor	2-5	Exibe várias configurações elétricas. Tipicamente não é usado pelo usuário.
	Muda para o modo usina	2-6	Não usado.
Muda para o modo usuário	2-7	Retorna ao modo usuário.	

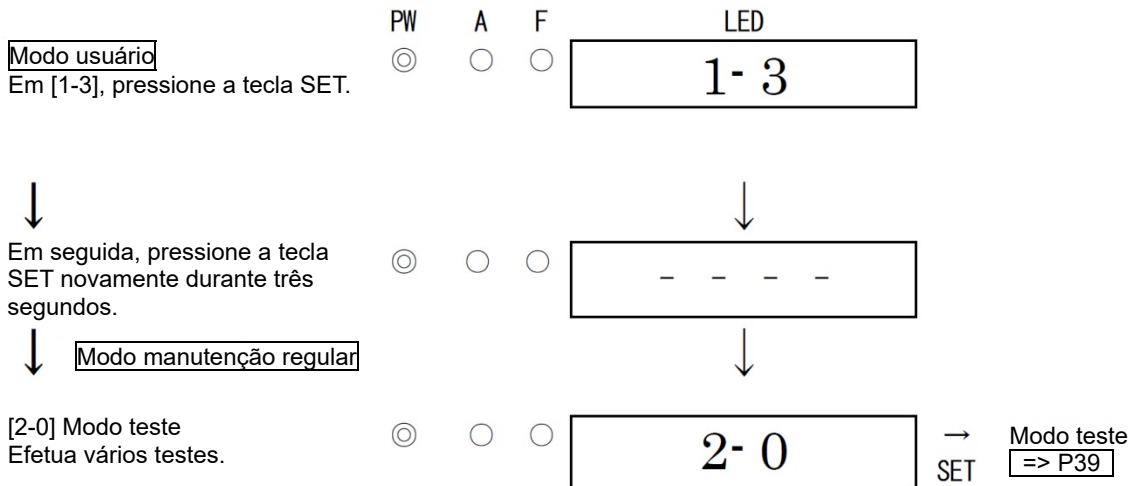

<p>[2-1] Ajuste zero (ajuste N₂) Executar o ajuste zero (ajuste N₂).</p>	<p>⊙ ○ ○</p>	<p style="text-align: center;">▲ ↓ ↑ ▼</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center; width: fit-content; margin: 0 auto;">2- 1</div>	<p>→ SET</p>	<p>Ajuste zero (ajuste N₂) => P46</p>
<p>[2-2] Ajuste de amplitude (ajuste AIR) Executa o ajuste de amplitude (ajuste AIR).</p>	<p>⊙ ○ ○</p>	<p style="text-align: center;">▲ ↓ ↑ ▼</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center; width: fit-content; margin: 0 auto;">2- 2</div>	<p>→ SET</p>	<p>Ajuste de amplitude (ajuste AIR) => P44</p>
<p>[2-3] Inicialização amplitude/zero Inicie o ajuste de amplitude/zero após substituir o sensor.</p>	<p>⊙ ○ ○</p>	<p style="text-align: center;">▲ ↓ ↑ ▼</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center; width: fit-content; margin: 0 auto;">2- 3</div>		
<p>[2-4] Definição ambiental Definir várias operações e funções.</p>	<p>⊙ ○ ○</p>	<p style="text-align: center;">▲ ↓ ↑ ▼</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center; width: fit-content; margin: 0 auto;">2- 4</div>	<p>→ SET</p>	<p>Definição ambiental => P43</p>
<p>[2-4.0] e [2-4.3] a [2-4.F] são predefinidos de fábrica. Tipicamente não são usados pelo usuário.</p>		<p style="text-align: center;">▲ ↓ ↑ ▼</p>		
<p>[2-5] Visor de várias configurações elétricas Exibe várias configurações elétricas. Não é usado pelo usuário.</p>	<p>⊙ ○ ○</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center; width: fit-content; margin: 0 auto;">2- 5</div>		
<p>[2-6] Entra no modo usina. Não é usado pelo usuário.</p>	<p>⊙ ○ ○</p>	<p style="text-align: center;">▲ ↓ ↑ ▼</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center; width: fit-content; margin: 0 auto;">2-6</div>		
<p>[2-7] Retorna ao modo usuário.</p>	<p>⊙ ○ ○</p>	<p style="text-align: center;">▲ ↓ ↑ ▼</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center; width: fit-content; margin: 0 auto;">2-7</div>	<p>→ SET</p>	<p>Exibe-se [rET]. Pressione a tecla SET novamente para retornar ao modo usuário.</p>
		<p style="text-align: center;">▲ ↓ ↑ ▼</p> <p style="text-align: center;">Para [2-0] Modo teste</p>		

<Modo teste [2-0]>

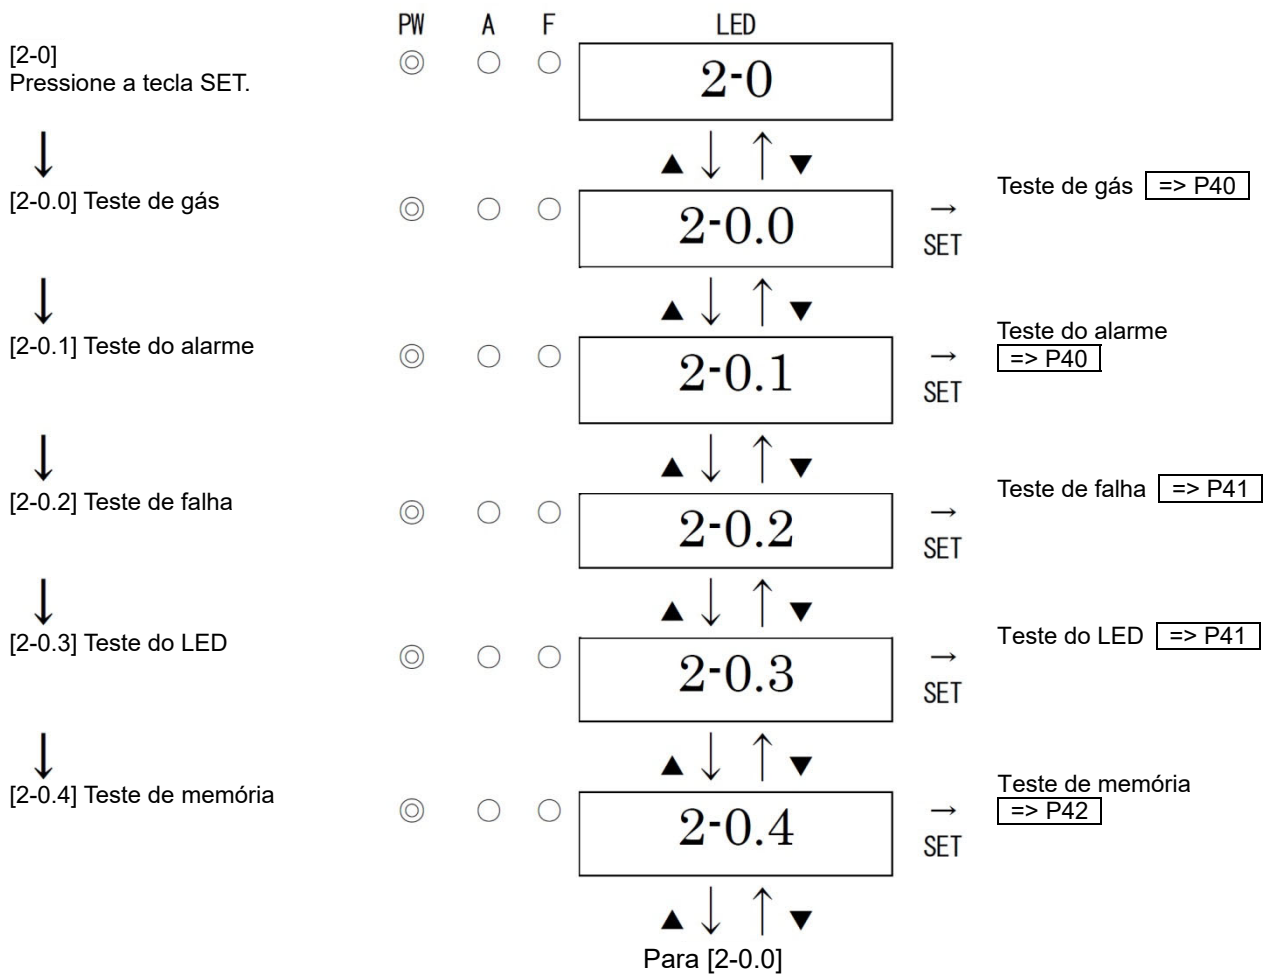**AVISO**

- Antes de iniciar o teste do alarme (teste de transmissão), forneça uma notificação às seções relacionadas para que elas possam preparar-se para anomalias falsas (sinais de saída externa e contato do alarme). Após a conclusão do teste, nunca deixe de pressionar a tecla MENU/ESC para retornar ao modo detecção. (Se o detector permanecer no modo teste do alarme, retorna automaticamente ao modo detecção no espaço de dez horas.)
- No modo teste do alarme, a concentração de gás igual à leitura sai sempre mesmo no modo manutenção, dependendo da definição. Se necessário, tome ações para que o lado do receptor de sinal possa preparar-se para evitar alarmes falsos.


<Teste de gás [2-0.0]>

[2-0.0]
Pressione a tecla SET.



Introduza o gás de teste e efetue o teste de gás.

Pare de introduzir o gás de teste. Quando a leitura aumentar, pressione a tecla MENU/ESC para cancelar o teste e voltar ao estado original.

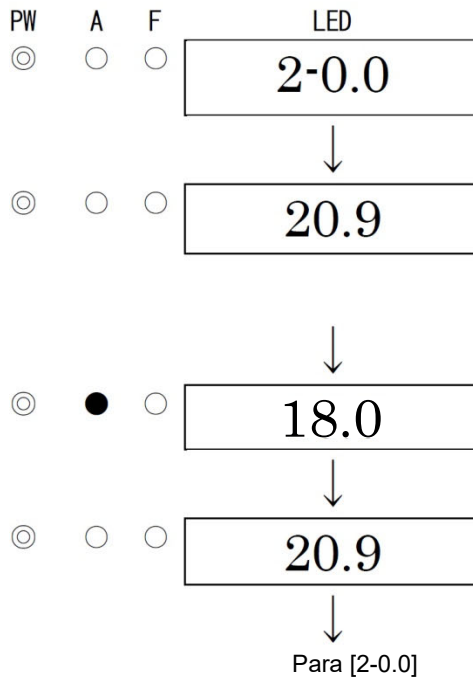

AVISO

Tenha cuidado para realizar o teste porque o contato e a saída de concentração de gás podem ser ativados por um teste de gás mesmo no modo de manutenção, dependendo do ajuste.


<Teste do alarme [2-0.1]>

[2-0.1]
Pressione a tecla SET.



LIGAR/DESLIGAR teste do alarme
(A definição do contato é "Alarme", ou "Alarme ou falha")
Selecione DESLIGAR/LIGAR e, em seguida, pressione a tecla SET.

Execute o teste de alarme aumentando ou diminuindo a leitura com a tecla ▲ ou ▼. Pressione a tecla MENU/ESC para cancelar o teste e retornar ao estado original.

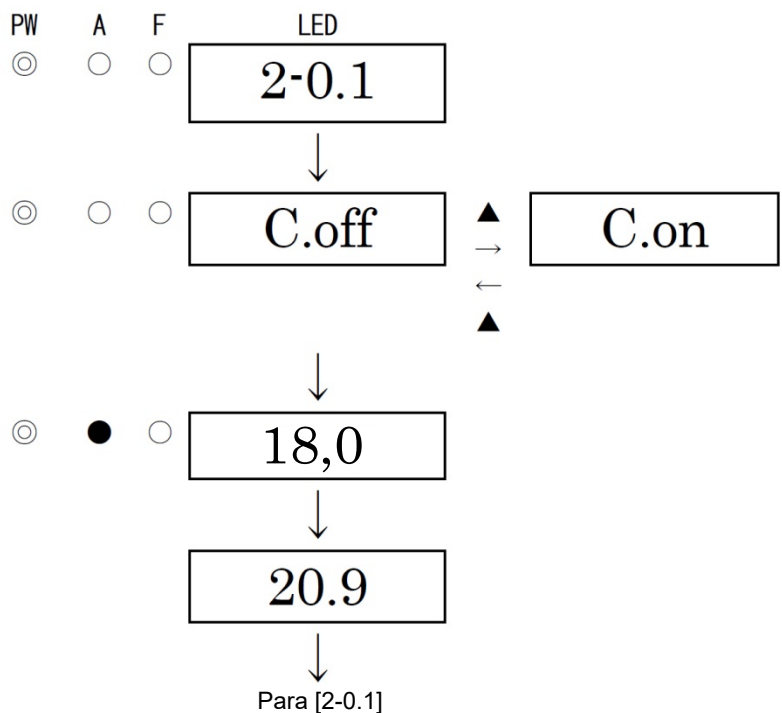

AVISO


Tenha cuidado para realizar o teste porque o contato e a saída de concentração de gás podem ser ativados por um teste de alarme, mesmo no modo de manutenção, dependendo do ajuste.

<Teste de Falha [2-0.2]>

[2-0.2]
Pressione a tecla SET.



LIGAR/DESLIGAR teste de falha
 Selecione [ON]/[OFF].
 Selecione [ON] e pressione a tecla SET para disparar o alarme de falha.
 Regresse a [OFF] e pressione a tecla SET para cancelar o teste.
 (Pressionar a tecla MENU/ESC também permite cancelar o teste e retornar ao estado original.)

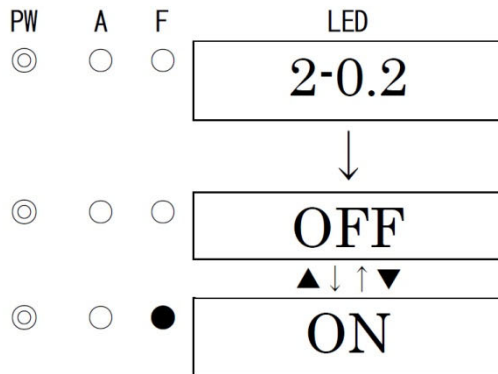

AVISO


Tenha cuidado para realizar o teste porque o contato e a saída de concentração de gás podem ser ativados por um teste de falha mesmo no modo de manutenção, dependendo do ajuste.

<Teste do LED [2-0.3]>


[2-0.3]
Pressione a tecla SET.



LIGAR/DESLIGAR teste do LED
 Selecione [ON]/[OFF].
 Selecione [ON] e pressione a tecla SET para ligar os LED (POWER, ALM, FAULT) e para exibir a concentração de gás de [8.8.8.8].
 Regresse a [OFF] e pressione a tecla SET para cancelar o teste.
 (Pressionar a tecla MENU/ESC também permite cancelar o teste e retornar ao estado original.)

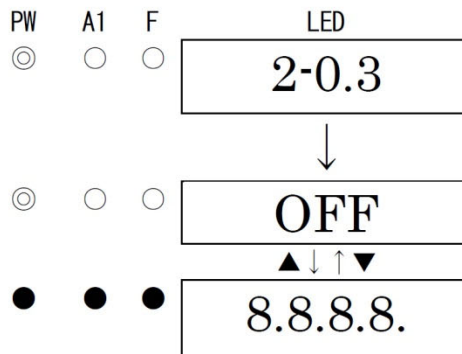

<Teste de memória [2-0.4]>

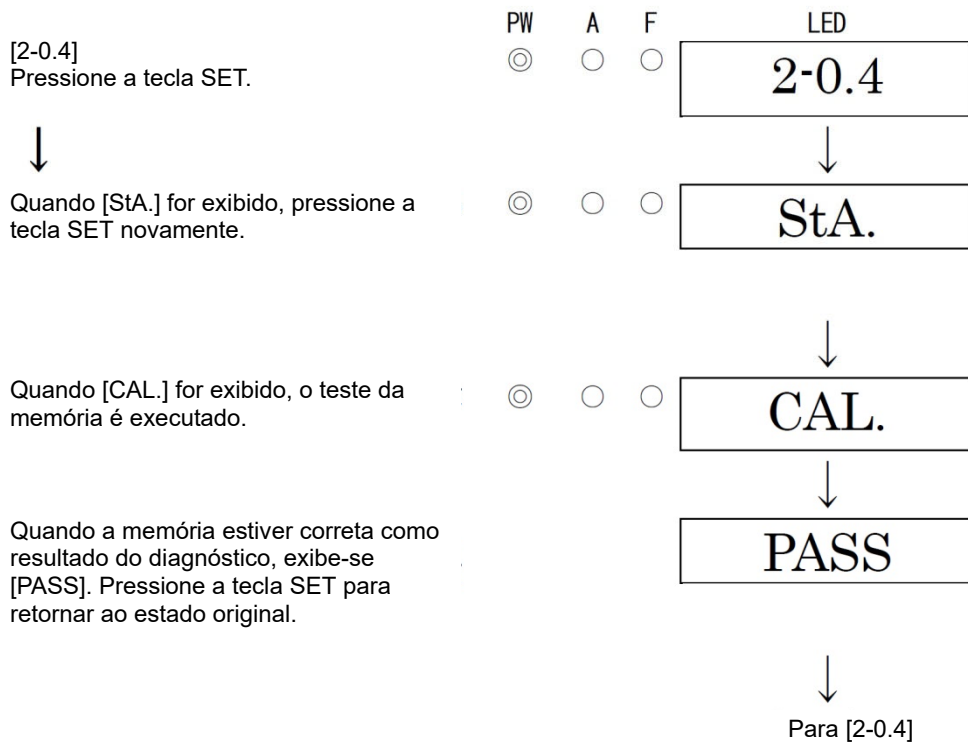**NOTA**

Quando forem detectadas anomalias na memória como resultado do diagnóstico, [PASS] não é exibido. É exibido [F-RA] para a falha da RAM e [F-RO] é exibido para a falha da ROM. Para a falha da RAM e a falha da ROM, [F-RA] e [F-RO] exibem-se alternadamente.


<Definição ambiental [2-4]>

Define várias operações e funções na definição ambiental.


<<Definição ambiental 1>>
[2-4] Definição ambiental
Pressione a tecla SET.



[2-4.0]
Estão definidos de fábrica e não são usados tipicamente pelo usuário.

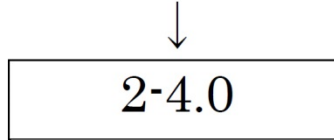


[2-4.1] DEFINIÇÃO INHIBIT
Definição INHIBIT.
Selecione [OFF]/[ON] e, em seguida, pressione a tecla SET para confirmar a seleção.
Quando se seleciona ON, no modo detecção [InHI.] e [0.0] (valor da concentração de gás) exibem-se alternadamente no LED. Como resultado, não é disparado um alarme para o dispositivo externo.

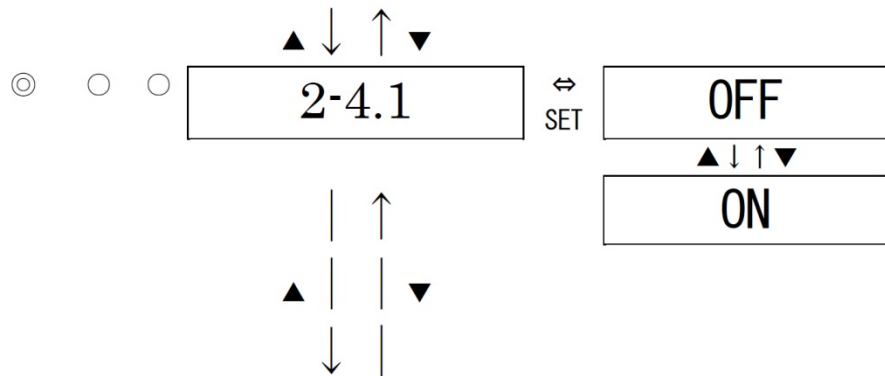

[2-4.2] Configuração do ponto de ajuste do alarme
Defina o ponto de ajuste do alarme.




[2-4.3] a [2-4.F]
Estão definidos de fábrica e não são usados tipicamente pelo usuário.

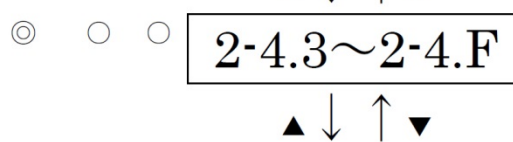

Para [2-4.0]

<Configuração do ponto de ajuste do alarme [2-4.2]>

[2-4.2]
Pressione a tecla SET.



Configuração do ponto de ajuste do alarme
Altere o valor pressionando a tecla ▲ ou ▼, e então pressione a tecla SET para confirmar o valor. (Pressione a tecla MENU/ESC para retornar ao estado original.)




Retorne ao [2-4.2]

7-3. Método de calibração

Efetue uma calibração em cada modo (modo de ajuste de zero e modo de ajuste de amplitude) usando o gás de calibração.

- Gás de ajuste zero (mais que N₂ 99,9 % coletado em uma bolsa de amostragem de gás)
- Gás de calibragem (Ar)
- Sacos de amostragem de gás

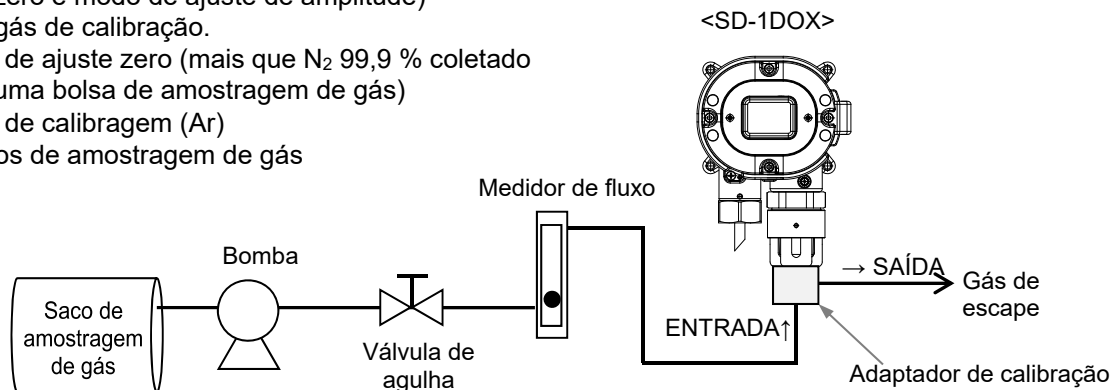

<Ajuste de amplitude (ajuste de AIR) [2-2]>

Isto é usado para realizar o ajuste de amplitude (ajuste AIR).




AVISO

Quando o ajuste da amplitude (ajuste AIR) é realizado na atmosfera, verifique se a atmosfera está fresca antes de iniciar o ajuste. Se existirem gases de interferência, o ajuste não pode ser efetuado adequadamente, conduzindo assim a perigos quando o gás vaza.



CUIDADO

- Antes de iniciar o ajuste de calibração (ajuste AIR), forneça ao detector o gás de calibração e aguarde até que a leitura esteja estabilizada.

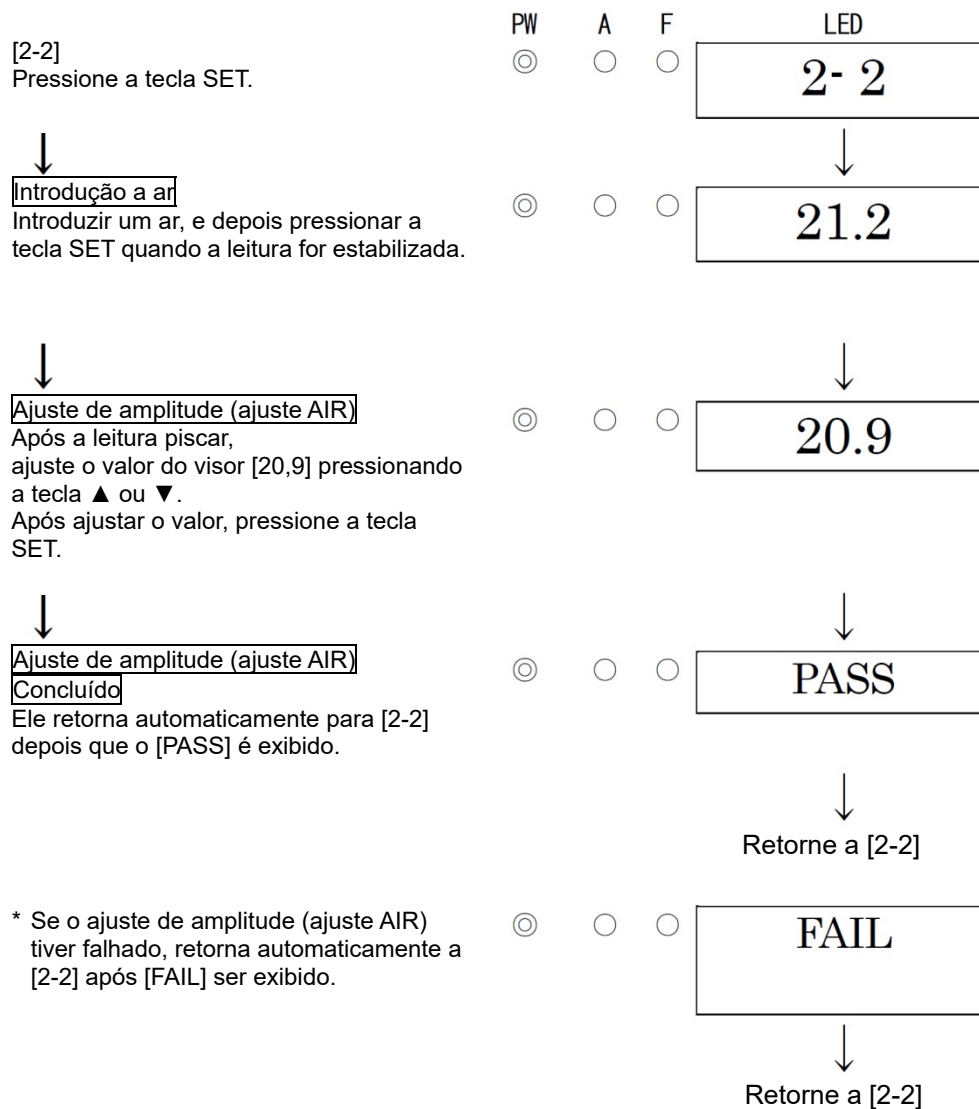

NOTA

- Se o ajuste de amplitude (ajuste AIR) falhou desde que a leitura oscilou significativamente a partir da concentração de gás introduzida, ele volta a [2-2] depois que [FAIL] em vez de [PASS] é exibido. Neste caso, o ajuste da amplitude (ajuste AIR) ainda não foi concluído. Verifique se a concentração correta do gás de calibração foi fornecida e verifique a ferramenta de ajuste de gás para um vazamento de gás. Se houver erros, executar novamente o ajuste de amplitude (ajuste AIR).
Se o ajuste de amplitude (ajuste AIR) não puder ser realizado mesmo quando não houver erro ou após a recalibração, a vida útil do sensor de gás pode ter expirado. Após desligar a fonte de alimentação, por favor, entre em contato com a RIKEN KEIKI.


<Ajuste zero (ajuste N₂) [2-1]>

Isto é usado para realizar o ajuste zero (ajuste N₂).

Quando o detector é usado para evitar a deficiência de oxigênio, não é necessário o ajuste zero.

NOTA

- Antes de iniciar o ajuste de zero (ajuste N₂), fornecer ao detector o ajuste de zero (mais que N₂ 99,9 vol%) do gás e esperar até que o indicador esteja estabilizado.

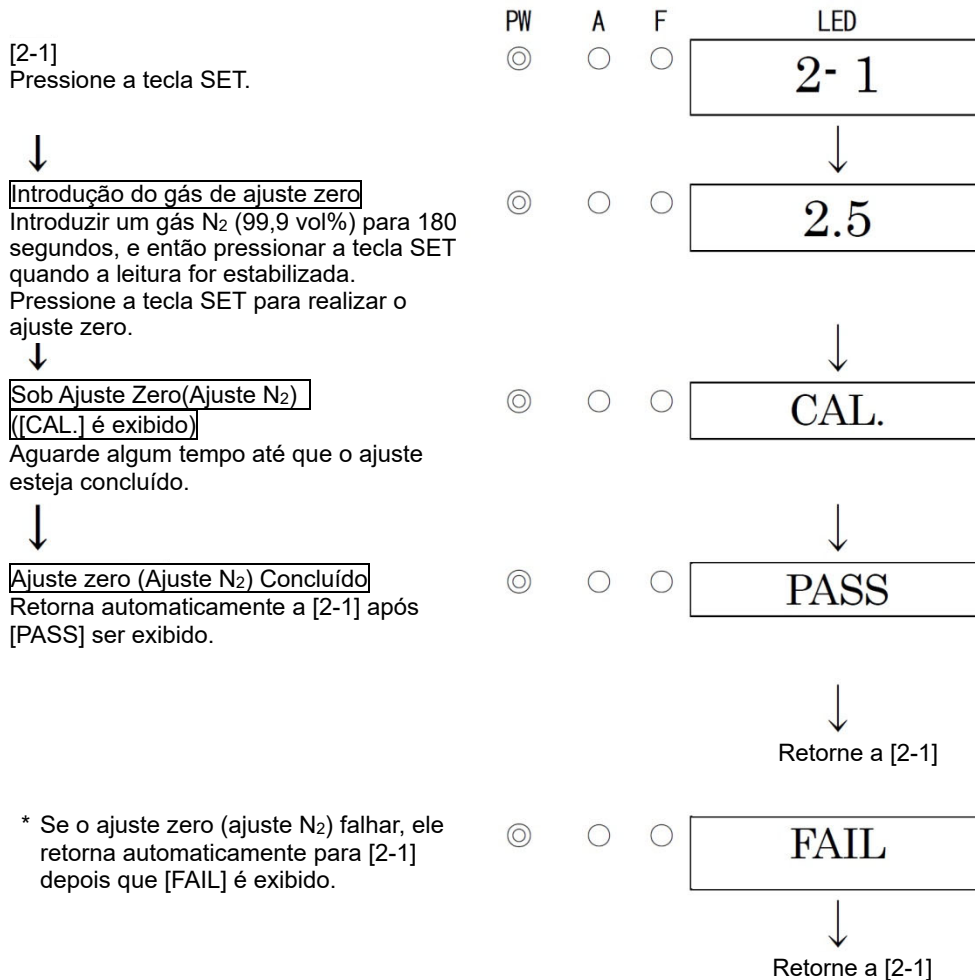**NOTA**

- Se o ajuste zero (ajuste N₂) falhou desde que o ponto zero flutuou significativamente de cerca de 0,0, ele retorna para [2-1] depois que [FAIL] em vez de [PASS] é exibido. Neste caso, o ajuste zero (ajuste N₂) ainda não foi concluído.

7-4. Peças de reposição

<Substituição do Sensor>

Nossos engenheiros de serviço precisam substituir o sensor e realizar a calibração. Por favor, entre em contato com a RIKEN KEIKI.

NOTA

A calibração usando o gás padrão é necessária depois que o sensor é substituído. Peça-o ao nosso departamento de vendas no estrangeiro ou aos representantes locais.

<Substituição de Peças de Substituição Regular>

Lista de peças de substituição regular recomendadas

Nº	Nome	Intervalos de manutenção	Intervalos de substituição (ano)	Quantidade (peças/unidade)
1	Vedação de borracha E (para o sensor) Anel em O (para o sensor/proteção) Vedação de borracha (para a tampa de sucção)	1 ano	3 - 6 anos	Cada 1

- * A operação deve ser verificada após substituição por um engenheiro de serviço qualificado. Para o funcionamento e a segurança estáveis da unidade, peça a um engenheiro de serviço qualificado que se encarregue da substituição de peças em que o funcionamento seja necessário verificar. Solicite à RIKEN KEIKI verificação da operação.

NOTA

- Os intervalos de substituição acima são apenas recomendações. Os intervalos podem variar dependendo das condições de operação. Esses intervalos não significam os períodos de garantia. O resultado da manutenção regular pode determinar quando substituir as peças.

8

Armazenamento, recolocação e eliminação

8-1. Procedimentos para armazenar o detector de gás ou deixá-lo fora de serviço durante um período longo

O detector de gás tem de ser armazenado sob as condições ambientais seguintes.

- Em um local escuro a temperatura e umidade normais, longe da luz solar direta.
- Em um local onde não estejam presentes gases, solventes ou vapores.

8-2. Procedimentos para realocar o detector ou usá-lo novamente

Quando o detector for realocado, selecione uma localização nova com o '4-2. Precauções para locais de instalação' e '4-4. Como instalar'.

Para mais informações sobre a ligação, ver '4-6. Como ligar'. O tempo sem alimentação deve ser minimizado quando o detector for relocado.



CUIDADO

- Ao usar um detector realocado ou parado/armazenado novamente, nunca deixe de realizar uma calibração. Para informações sobre reajuste incluindo uma calibração, entre em contato com a RIKEN KEIKI.

8-3. Eliminação de produtos

Para descartar o detector, é necessário que seja tratado adequadamente como um resíduo industrial de acordo com os regulamentos locais.

9

Resolução de problemas

A resolução de problemas não explica as causas de todas as anomalias que ocorrem no detector. Simplesmente ajuda a encontrar as causas de anomalias que ocorrem frequentemente. Se o detector mostrar um sintoma que não esteja explicado neste manual, ou ainda tenha anomalias apesar de se tomarem ações de correção, contacte o nosso departamento de vendas no estrangeiro ou os representantes locais.

<Anomalias na Unidade>

Sintoma/visor	FAULT	Causas	Ações
<u>A alimentação não pode ser ligada.</u>	-	A ligação não está correta.	Conecte a ligação corretamente.
		A placa terminal está removida.	Conecte a placa terminal corretamente.
		Anomalias/falha de energia momentâneas do sistema de alimentação.	Forneça a voltagem nominal. Tome medidas tais como verificar ou adicionar a UPS, o filtro em linha da fonte de alimentação e o transformador de isolamento.
		Anomalias do cabo (circuito aberto/não conectado/curto-circuito)	Verifique a ligação do detector e os dispositivos relacionados periféricos.
<u>Operações anormais</u>	-	Perturbações por ruído de pico súbito, etc.	Desligue e reinicie a unidade do alarme / indicador. Se tal sintoma se observar frequentemente, tome as medidas adequadas para eliminar o ruído.
<u>Anomalias do sensor [E-1]</u>	•	O sensor não está conectado, ou está conectado incorretamente.	Verifique se o cabo está firmemente fixado na placa terminal.
		Falhas do sensor	Substitua o sensor por um novo.
<u>Anomalias do sistema [E-9]</u>	•	A voltagem nominal não é fornecida para o detector.	Verifique a fonte de alimentação e forneça a voltagem nominal.
		Anomalias da ROM, RAM, ou EEPROM dentro do detector.	Contacte o nosso departamento de vendas no estrangeiro ou os representantes locais.
		A saída externa 4 - 20 mA não é produzida corretamente	Verificar se o cabo para saída externa está conectado corretamente. (Deterioração do cabo, conexão do sistema host, etc.). Se a saída não for necessária, conectar uma resistência ao terminal, como mencionado em P19. Se estiver conectado corretamente, entre em contato com nosso departamento de vendas no exterior ou com agentes locais, pois pode ocorrer uma falha dentro deste detector.

<Anomalias das Leituras>

Sintomas	Causas	Ações
<u>A leitura sobe (desce) e permanece inalterada.</u>	Flutuação da saída do sensor.	Executar o ajuste de zero (ou ajuste de amplitude).
	Vazão lenta	Uma quantidade muito pequena do gás a ser detectado pode estar vazando (vazão lenta). Se ignorar isso pode causar perigos. Tome uma medida de correção, por ex., tomando ações como as para o alarme de gás.
	Alterações ambientais	Executar o ajuste de zero (ou ajuste de amplitude).
<u>Um alarme de gás dispara apesar de não existir vazão de gás e não haver outras anomalias no ponto de detecção.</u>	Perturbação por ruído	Desligue e reinicie o detector. Se tal sintoma se observar frequentemente, tome as medidas adequadas para eliminar o ruído.
	Alteração súbita no ambiente.	Quando o ambiente (temperatura, etc.) muda subitamente, o detector não pode ajustar-se e é afetado por isso. Em alguns casos, o detector dispara um alarme de indicação. Como o detector não pode ser usado sob alterações ambientais frequentes e súbitas, o usuário deve tomar quaisquer ações preventivas para eliminá-las.
<u>Resposta lenta</u>	Filtro do pó entupido	Substitua o filtro do pó.
	Tubo de sucção ou de exaustão dobrado, entupido ou com vazamento	Repare as peças com defeito.
	Forma-se condensação no interior do tubo de sucção.	Repare as peças com defeito.
	Sensibilidade do sensor deteriorada	Substitua o sensor por um novo.
<u>Impossível efetuar o ajuste de amplitude</u>	Concentração do gás de calibração inadequada	Use o gás de calibração adequado.
	Sensibilidade do sensor deteriorada	Substitua o sensor por um novo.

10

Especificações do produto

10-1. Lista de especificações

<ATEX/IECEX/INMETRO Especificações do Alarme de Deficiência de Oxigênio>

Modelo	SD-1DOX
Princípio de detecção	Método de célula galvânica
Gás de detecção	O ₂
Visor de concentração	LED (4 dígitos·7 segmentos)
Faixa de detecção	0 - 25 vol%
Método de detecção	Método de sucção (despejado por unidade externa)
Taxa de sucção	1,5 ± 0,1 L/min
Pontos de ajuste do alarme	18 vol% (L) 【Padrão】
Visor de alimentação	Iluminação da lâmpada POWER (verde)
Saída externa	Sinal de concentração de gás Contato do alarme (alarme de gás ou alarme de falha ou Gas·Fault alarme comum)
Indicar a precisão*1 (Sob uma condição idêntica)	Dentro de ±0,7 vol%
Precisão do ponto de ajuste do alarme*1	A diferença entre o ponto de ajuste do alarme e o valor indicado do alarme de advertência é zero.
Tempo de resposta*1 (Sob uma condição idêntica)	Dentro de 30 seg (T90) (sem tempo de atraso da tubulação)
Tempo de atraso do alarme*1 (Sob uma condição idêntica)	Por alarme de anoxia (pontos de ajuste do alarme: 18 vol%), Menos de 5 sec. (Ao introduzir 10 - 11 vol% de gás) (Sem tempo de atraso de tubulação)
Tipo de alarme de gás	Alarme único (L)
Visor de alarme de gás	Iluminação da lâmpada ALM (vermelha)
Padrão do alarme de gás	Autorrecuperação
Alarme de falha·Autodiagnóstico	Falha do sistema/Falha do sensor
Visor do alarme de falha	Iluminação da lâmpada FAULT (amarela)/monitor de conteúdo
Padrão do alarme de falha	Autorrecuperação
Contato do alarme	Contato sem voltagem 1a·Sem estímulo em normal (estímulo em alarme) ou estímulo em normal (sem estímulo em alarme)
Capacidade de contato	30 V CC - 0,5 A (carga resistiva)
Esquema de transmissão	Transmissão analógica a três fios (em comum com a fonte de alimentação <fonte de alimentação,sinal,comum>)
Especificação de transmissão	4 - 20 mA CC (resistência linear/carga inferior a 300 Ω)
Cabo de transmissão	CVVS 1,25 mm ² ou 2,0 mm ² - 3 núcleos (quando o contato não é usado) CVVS 1,25 mm ² ou 2,0 mm ² - 5 núcleos (quando o contato é usado)
Distância de transmissão	Menos que 1,25 km no caso de CVVS 1,25 mm ² Menos que 2,0 km no caso de CVVS 2,0 mm ²
Fonte de alimentação	24 V CC ± 10 %
Funções	Supressão/atraso do alarme
Consumo de energia	MAX. 1,1 W
Porto de cabeamento	Adaptador A <NPT1/2> ou Adaptador B <NPT3/4> ou Método de embalagem à prova de chama <G3/4> (Cabos compatíveis φ9,6 - 13,0 mm de diâmetro externo)
Porta de conexão do tubo	Rc 1/8 (com união de cotovelo PP para tubo D.Eφ6-1t·PTFE)
Ligação inicial	Aprox. 25 seg
Faixa de temperatura de operação	-10 - +40 °C (sem rápida variação)
Faixa de umidade de operação	Menos de 95 % de UR (sem condensação)
Estrutura	Tipo de montagem na parede
Construção protegida contra explosões	Estrutura à prova de chamas
Classe à prova de explosão	II 2 G Ex db II C T6 Gb(ATEX) / Ex db II C T6 Gb(IECEX/INMETRO)
Dimensões	Aprox. 148 (L) × 205 (A) × 88 (P) mm (excluindo porções de projeção)
Peso	Aprox. 2,9 kg
Cor	Munsell 7.5BG5/2

*1 Em conformidade com o JIS T8201 2010 (Indicador de deficiência de oxigênio)

<ATEX/IECEX/INMETRO Especificações do alarme de vazamento>


Modelo	SD-1DOX
Princípio de detecção	Método de célula galvânica
Gás de detecção	O ₂
Visor de concentração	LED (4 dígitos·7 segmentos)
Faixa de detecção	0 - 50 vol%
Método de detecção	Método de sucção (despejado por unidade externa)
Taxa de sucção	1,5 ± 0,1 L/min
Pontos de ajuste do alarme	25 vol% (H) 【Padrão】
Visor de alimentação	Iluminação da lâmpada POWER (verde)
Saída externa	Sinal de concentração de gás Contato do alarme (alarme de gás ou alarme de falha ou Gas·Fault alarme comum)
Precisão do alarme (Sob uma condição idêntica)	Dentro de ±5 vol% para alarme de vazamento (valor do ponto de ajuste do alarme: 25 vol%)
Tempo de atraso de alarme (Sob uma condição idêntica)	Por alarme de vazamento (valor do ponto de ajuste do alarme: 25 vol%), dentro de 30 seg. após fornecer o gás 1,6 vezes. (Sem tempo de atraso da tubulação)
Tipo de alarme de gás	Alarme único (H)
Visor de alarme de gás	Iluminação da lâmpada ALM (vermelha)
Padrão do alarme de gás	Autorrecuperação
Alarme de falha· Autodiagnóstico	Falha do sistema/Falha do sensor
Visor do alarme de falha	Iluminação da lâmpada FAULT (amarela)/monitor de conteúdo
Padrão do alarme de falha	Autorrecuperação
Contato do alarme	Contato sem voltagem 1a·Sem estímulo em normal (estímulo em alarme) ou estímulo em normal (sem estímulo em alarme)
Capacidade de contato	30 V CC - 0,5 A (carga resistiva)
Esquema de transmissão	Transmissão analógica a três fios (em comum com a fonte de alimentação <fonte de alimentação,sinal,comum>)
Especificação de transmissão	4 - 20 mA CC (resistência linear/carga inferior a 300 Ω)
Cabo de transmissão	CVVS 1,25 mm ² ou 2,0 mm ² - 3 núcleos (quando o contato não é usado) CVVS 1,25 mm ² ou 2,0 mm ² - 5 núcleos (quando o contato é usado)
Distância de transmissão	Menos que 1,25 km no caso de CVVS 1,25 mm ² Menos que 2,0 km no caso de CVVS 2,0 mm ²
Fonte de alimentação	24 V CC ± 10 %
Funções	Supressão/atraso do alarme
Consumo de energia	MAX. 1,1 W
Porto de cabeamento	Adaptador A <NPT1/2> ou Adaptador B <NPT3/4> ou Método de embalagem à prova de chama <G3/4> (Cabos compatíveis φ9,6 - 13,0 mm de diâmetro externo)
Porta de conexão do tubo	Rc 1/8 (com união de cotovelo PP para tubo D.Eφ6-1t·PTFE)
Ligação inicial	Aprox. 25 seg
Faixa de temperatura de operação	-10 - +40 °C (sem rápida variação)
Faixa de umidade de operação	Menos de 95 % de UR (sem condensação)
Estrutura	Tipo de montagem na parede
Construção protegida contra explosões	Estrutura à prova de chamas
Classe à prova de explosão	II 2 G Ex db II C T6 Gb(ATEX) / Ex db II C T6 Gb(IECEX/INMETRO)
Dimensões	Aprox. 148 (L) × 205 (A) × 88 (P) mm (excluindo porções de projeção)
Peso	Aprox. 2,9 kg
Cor	Munsell 7.5BG5/2

<ATEX/IECEX/INMETRO Especificações de monitoramento de gás>

Modelo	SD-1DOX
Princípio de detecção	Método de célula galvânica
Gás de detecção	O ₂
Visor de concentração	LED (4 dígitos·7 segmentos)
Faixa de detecção	0 - 5 vol%/0 - 10 vol%/0 - 25 vol%/0 - 50 vol%/0 - 100 vol%
Método de detecção	Método de sucção (despejado por unidade externa)
Taxa de sucção	1,5 ± 0,1 L/min
Pontos de ajuste do alarme	Depende do alcance de detecção
Visor de alimentação	Iluminação da lâmpada POWER (verde)
Saída externa	Sinal de concentração de gás Contato do alarme (alarme de gás ou alarme de falha ou Gas·Fault alarme comum)
Indica precisão (Sob uma condição idêntica)	Dentro de ±0,7 vol% (abaixo da faixa de 25 vol%) Dentro de ±3 vol% (acima da faixa de 25 vol%)
Tempo de resposta (Sob uma condição idêntica)	Dentro de 30 seg (T90) (sem tempo de atraso da tubulação)
Tipo de alarme de gás	Alarme único (H ou L)
Visor de alarme de gás	Iluminação da lâmpada ALM (vermelha)
Padrão do alarme de gás	Autorrecuperação
Alarme de falha· Autodiagnóstico	Falha do sistema/Falha do sensor
Visor do alarme de falha	Iluminação da lâmpada FAULT (amarela)/monitor de conteúdo
Padrão do alarme de falha	Autorrecuperação
Contato do alarme	Contato sem voltagem 1a·Sem estímulo em normal (estímulo em alarme) ou estímulo em normal (sem estímulo em alarme)
Capacidade de contato	30 V CC - 0,5 A (carga resistiva)
Esquema de transmissão	Transmissão analógica a três fios (em comum com a fonte de alimentação <fonte de alimentação,sinal,comum>)
Especificação de transmissão	4 - 20 mA CC (resistência linear/carga inferior a 300 Ω)
Cabo de transmissão	CVVS 1,25 mm ² ou 2,0 mm ² - 3 núcleos (quando o contato não é usado) CVVS 1,25 mm ² ou 2,0 mm ² - 5 núcleos (quando o contato é usado)
Distância de transmissão	Menos que 1,25 km no caso de CVVS 1,25 mm ² Menos que 2,0 km no caso de CVVS 2,0 mm ²
Fonte de alimentação	24 V CC ± 10 %
Funções	Supressão/atraso do alarme
Consumo de energia	MAX. 1,1 W
Porto de cabeamento	Adaptador A <NPT1/2> ou Adaptador B <NPT3/4> ou Método de embalagem à prova de chama <G3/4>(Cabos compatíveis φ9,6 - 13,0 mm de diâmetro externo)
Porta de conexão do tubo	Rc 1/8 (com união de cotovelo PP para tubo D.Eφ6-1t·PTFE)
Ligação inicial	Aprox. 25 seg
Faixa de temperatura de operação	-10 - +40 °C (sem rápida variação)
Faixa de umidade de operação	Menos de 95 % de UR (sem condensação)
Estrutura	Tipo de montagem na parede
Construção protegida contra explosões	Estrutura à prova de chamas
Classe à prova de explosão	II 2 G Ex db II C T6 Gb(ATEX) / Ex db II C T6 Gb(IECEX/INMETRO)
Dimensões	Aprox. 148 (L) × 205 (A) × 88 (P) mm (excluindo porções de projeção)
Peso	Aprox. 2,9 kg
Cor	Munsell 7.5BG5/2

Desenhos esboço

【Adaptador A <NPT1/2>】

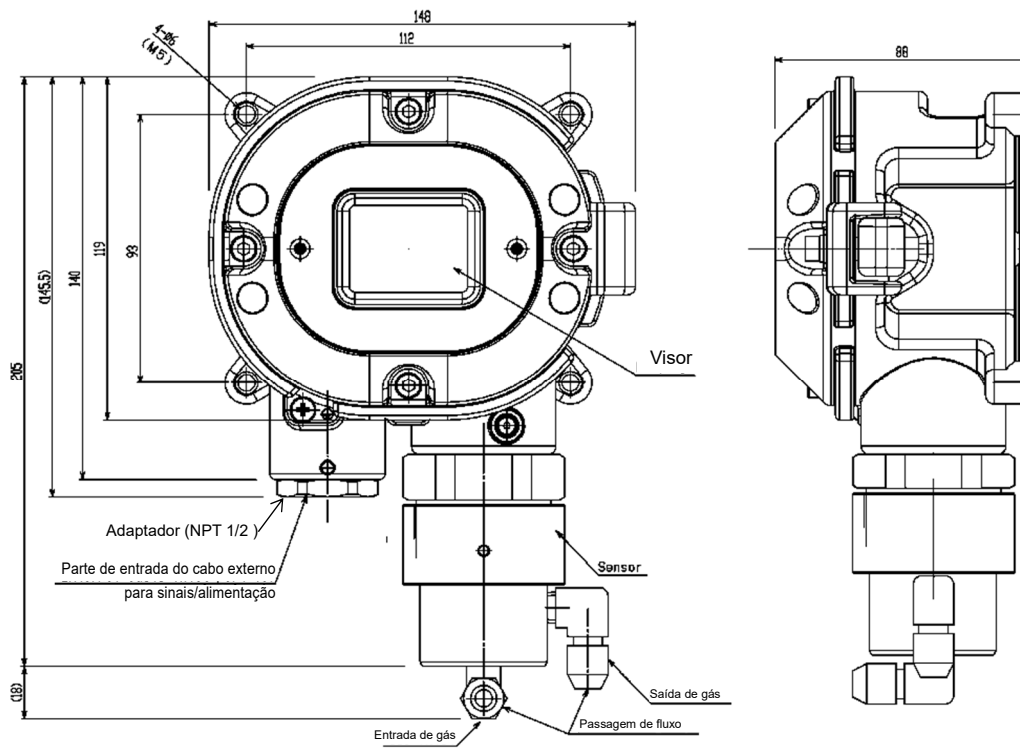

<Japan Ex/Especificações do Alarme de Deficiência de Oxigênio>

Modelo	SD-1DOX
Princípio de detecção	Método de célula galvânica
Gás de detecção	O ₂
Visor de concentração	LED (4 dígitos·7 segmentos)
Faixa de detecção	0 - 25 vol%
Método de detecção	Método de sucção (despejado por unidade externa)
Taxa de sucção	1,5 ± 0,1 L/min
Pontos de ajuste do alarme	18 vol% (L) 【Padrão】
Visor de alimentação	Iluminação da lâmpada POWER (verde)
Saída externa	Sinal de concentração de gás Contato do alarme (alarme de gás ou alarme de falha ou Gas·Fault alarme comum)
Indicar a precisão*1 (Sob uma condição idêntica)	Dentro de ±0,7 vol%
Precisão do ponto de ajuste do alarme*1	A diferença entre o ponto de ajuste do alarme e o valor indicado do alarme de advertência é zero.
Tempo de resposta*1 (Sob uma condição idêntica)	Dentro de 30 seg (T90) (sem tempo de atraso da tubulação)
Tempo de atraso do alarme*1 (Sob uma condição idêntica)	Por alarme de anoxia (Ponto de pré-ajuste do alarme:18 vol%), Menos de 5 sec. (Ao introduzir 10 - 11 vol% de gás) (Sem tempo de atraso de tubulação)
Tipo de alarme de gás	Alarme único (L)
Visor de alarme de gás	Iluminação da lâmpada ALM (vermelha)
Padrão do alarme de gás	Autorrecuperação
Alarme de falha· Autodiagnóstico	Falha do sistema/Falha do sensor
Visor do alarme de falha	Iluminação da lâmpada FAULT (amarela)/monitor de conteúdo
Padrão do alarme de falha	Autorrecuperação
Contato do alarme	Contato sem voltagem 1a·Sem estímulo em normal (estímulo em alarme) ou estímulo em normal (sem estímulo em alarme)
Capacidade de contato	250 V CA - 0,5 A/30 V CC - 0,5 A (carga resistiva)
Esquema de transmissão	Transmissão analógica a três fios (em comum com a fonte de alimentação <fonte de alimentação,sinal,comum>)
Especificação de transmissão	4 - 20 mA CC (resistência linear/carga inferior a 300 Ω)
Cabo de transmissão	CVVS 1,25 mm ² ou 2,0 mm ² - 3 núcleos (quando o contato não é usado) CVVS 1,25 mm ² ou 2,0 mm ² - 5 núcleos (quando o contato é usado)
Distância de transmissão	Menos que 1,25 km no caso de CVVS 1,25 mm ² Menos que 2,0 km no caso de CVVS 2,0 mm ²
Fonte de alimentação	24 V CC ± 10 %
Funções	Supressão/atraso do alarme
Consumo de energia	MAX. 1,1 W
Porto de cabeamento	Método de embalagem à prova de fogo <G3/4> (Cabos compatíveis φ9,6 - 13,0 mm no diâmetro externo)
Porta de conexão do tubo	Rc 1/8 (com união de cotovelo PP para tubo D.Eφ6-1t·PTFE)
Ligação inicial	Aprox. 25 seg
Faixa de temperatura de operação	-10 - +40 °C (sem rápida variação)
Faixa de umidade de operação	Menos de 95 % de UR (sem condensação)
Estrutura	Tipo de montagem na parede
Construção protegida contra explosões	Estrutura à prova de chamas
Classe à prova de explosão	Ex d II C T6 X
Dimensão	Aprox.148 (L) × 205 (A) × 88 (P) mm (excluindo porções de projeção)
Peso	Aprox. 2,9 kg
Cor	Munsell 7.5BG5/2

*1 Em conformidade com o JIS T8201 2010 (Indicador de deficiência de oxigênio)

<Japan Ex/Especificações do Alarme de Vazamento>


Modelo	SD-1DOX
Princípio de detecção	Método de célula galvânica
Gás de detecção	O ₂
Visor de concentração	LED (4 dígitos·7 segmentos)
Faixa de detecção	0 - 50 vol%
Método de detecção	Método de sucção (despejado por unidade externa)
Taxa de sucção	1,5 ± 0,1 L/min
Pontos de ajuste do alarme	25 vol% (H) 【Padrão】
Visor de alimentação	Iluminação da lâmpada POWER (verde)
Saída externa	Sinal de concentração de gás Contato do alarme (alarme de gás ou alarme de falha ou Gas·Fault alarme comum)
Precisão do alarme (Sob uma condição idêntica)	Dentro de ±5 vol% para alarme de vazamento (valor do ponto de ajuste do alarme: 25 vol%)
Tempo de atraso de alarme (Sob uma condição idêntica)	Por alarme de vazamento (valor do ponto de ajuste do alarme: 25 vol%), Dentro de 30 seg. após fornecer o gás 1,6 vezes (sem tempo de atraso da tubulação)
Tipo de alarme de gás	Alarme único (H)
Visor de alarme de gás	Iluminação da lâmpada ALM (vermelha)
Padrão do alarme de gás	Autorrecuperação
Alarme de falha· Autodiagnóstico	Falha do sistema/Falha do sensor
Visor do alarme de falha	Iluminação da lâmpada FAULT (amarela)/monitor de conteúdo
Padrão do alarme de falha	Autorrecuperação
Contato do alarme	Contato sem voltagem 1a·Sem estímulo em normal (estímulo em alarme) ou estímulo em normal (sem estímulo em alarme)
Capacidade de contato	250 V CA - 0,5 A/30 V CC - 0,5 A (carga resistiva)
Esquema de transmissão	Transmissão analógica a três fios (em comum com a fonte de alimentação <fonte de alimentação,sinal,comum>)
Especificação de transmissão	4 - 20 mA CC (resistência linear/carga inferior a 300 Ω)
Cabo de transmissão	CVVS 1,25 mm ² ou 2,0 mm ² - 3 núcleos (quando o contato não é usado) CVVS 1,25 mm ² ou 2,0 mm ² - 5 núcleos (quando o contato é usado)
Distância de transmissão	Menos que 1,25 km no caso de CVVS 1,25 mm ² Menos que 2,0 km no caso de CVVS 2,0 mm ²
Fonte de alimentação	24 V CC ± 10 %
Funções	Supressão/atraso do alarme
Consumo de energia	MAX. 1,1 W
Porto de cabeamento	Método de embalagem à prova de fogo <G3/4> (Cabos compatíveis φ9,6 - 13,0 mm no diâmetro externo)
Porta de conexão do tubo	Rc 1/8 (com união de cotovelo PP para tubo D.Eφ6-1t·PTFE)
Ligação inicial	Aprox. 25 seg
Faixa de temperatura de operação	-10 - +40 °C (sem rápida variação)
Faixa de umidade de operação	Menos de 95 % de UR (sem condensação)
Estrutura	Tipo de montagem na parede
Construção protegida contra explosões	Estrutura à prova de chamas
Classe à prova de explosão	Ex d II C T6 X
Dimensão	Aprox. 148 (L) × 205 (A) × 88 (P) mm (excluindo porções de projeção)
Peso	Aprox. 2,9 kg
Cor	Munsell 7.5BG5/2

<Japan Ex/Especificações de monitoramento de gás>

Modelo	SD-1DOX
Princípio de detecção	Método de célula galvânica
Gás de detecção	O ₂
Visor de concentração	LED (4 dígitos·7 segmentos)
Faixa de detecção	0 - 5 vol%/0 - 10 vol%/0 - 25 vol%/0 - 50 vol%/0 - 100 vol%
Método de detecção	Método de sucção (despejado por unidade externa)
Taxa de sucção	1,5 ± 0,1 L/min
Pontos de ajuste do alarme	Depende do alcance de detecção
Visor de alimentação	Iluminação da lâmpada POWER (verde)
Saída externa	Sinal de concentração de gás Contato do alarme (alarme de gás ou alarme de falha ou Gas·Fault alarme comum)
Indica precisão (Sob uma condição idêntica)	Dentro de ±0,7 vol% (abaixo da faixa de 25 vol%) Dentro de ±3 vol% (acima da faixa de 25 vol%)
Tempo de resposta (Sob uma condição idêntica)	Dentro de 30 seg (T90) (sem tempo de atraso da tubulação)
Tipo de alarme de gás	Alarme único (H ou L)
Visor de alarme de gás	Iluminação da lâmpada ALM (vermelha)
Padrão do alarme de gás	Autorrecuperação
Alarme de falha· Autodiagnóstico	Falha do sistema/Falha do sensor
Visor do alarme de falha	Iluminação da lâmpada FAULT (amarela)/monitor de conteúdo
Padrão do alarme de falha	Autorrecuperação
Contato do alarme	Contato sem voltagem 1a·Sem estímulo em normal (estímulo em alarme) ou estímulo em normal (sem estímulo em alarme)
Capacidade de contato	250 V CA - 0,5 A/30 V CC - 0,5 A (carga resistiva)
Esquema de transmissão	Transmissão analógica a três fios (em comum com a fonte de alimentação <fonte de alimentação,sinal,comum>)
Especificação de transmissão	4 - 20 mA CC (resistência linear/carga inferior a 300 Ω)
Cabo de transmissão	CVVS 1,25 mm ² ou 2,0 mm ² - 3 núcleos (quando o contato não é usado) CVVS 1,25 mm ² ou 2,0 mm ² - 5 núcleos (quando o contato é usado)
Distância de transmissão	Menos que 1,25 km no caso de CVVS 1,25 mm ² Menos que 2,0 km no caso de CVVS 2,0 mm ²
Funções	Supressão/atraso do alarme
Fonte de alimentação	24 V CC ± 10 %
Consumo de energia	MAX. 1,1 W
Porto de cabeamento	Método de embalagem à prova de fogo <G3/4> (Cabos compatíveis φ9,6 - 13,0 mm no diâmetro externo)
Porta de conexão do tubo	Rc 1/8 (com união de cotovelo PP para tubo D.Eφ6-1t·PTFE)
Ligação inicial	Aprox. 25 seg
Faixa de temperatura de operação	-10 - +40 °C (sem rápida variação)
Faixa de umidade de operação	Menos de 95 % de UR (sem condensação)
Estrutura	Tipo de montagem na parede Estrutura à prova de chamas
Classe à prova de explosão	Ex d IIC T6 X
Dimensões	Aprox. 148 (L) × 205 (A) × 88 (P) mm (excluindo porções de projeção)
Peso	Aprox. 2,9 kg
Cor	Munsell 7.5BG5/2

Desenhos esboço


【Bucim do cabo <G3/4>】

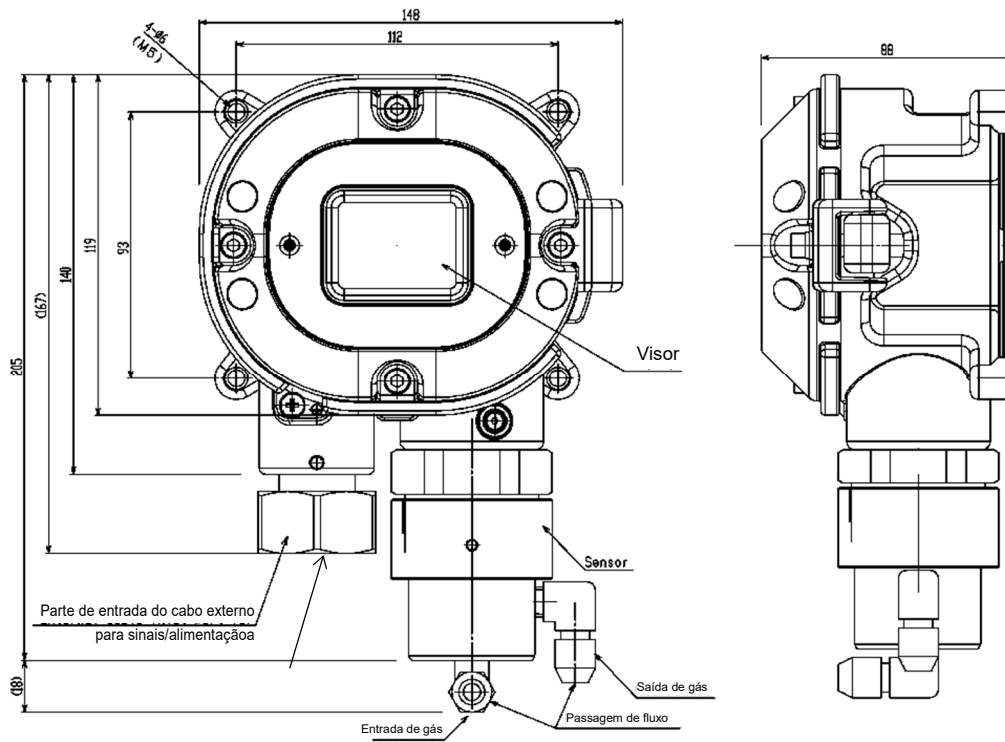

10-2. Princípio de detecção

[Princípio de detecção]

Um eletrodo negativo de metal nobre e um eletrodo positivo de chumbo são colocados em um recipiente de resina preenchido com eletrólito. Uma parte do recipiente é aberta e coberta com uma barreira. O eletrodo negativo é instalado em contato com a barreira. Os fios de chumbo são tirados dos eletrodos positivos e negativos para obter saídas. Um termistor é conectado entre os fios de chumbo para realizar a compensação de temperatura para as saídas do sensor.

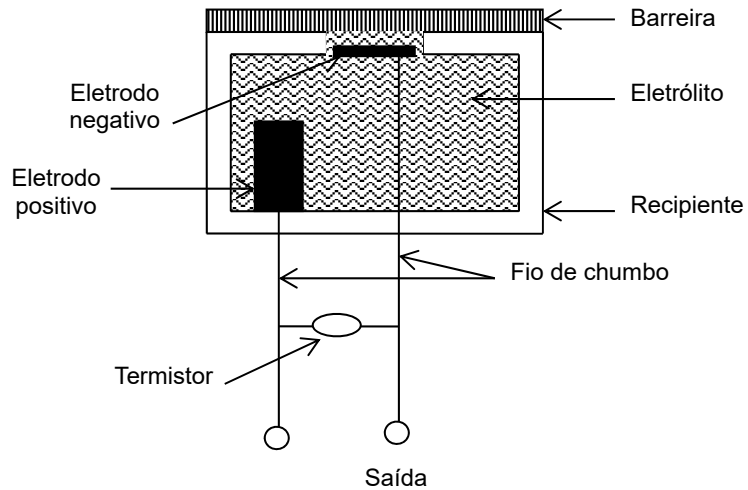

11

Definição de termos

Tipo de célula galvânica	Este é um princípio do sensor instalado na cabeça detectora. Veja o '10-2. Princípio de detecção' para detalhes.
Ligação inicial	A saída da cabeça do detector flutua durante algum tempo após ligar a alimentação. Esta é uma função que serve para evitar o disparo de um alarme durante esse tempo.
Escala máxima	Valor máximo da faixa de detecção.
vol%	Uma unidade usada para expressar a porcentagem de uma substância específica (ou gás) em um volume de solução.
Atmosfera	Uma atmosfera com uma temperatura dentro da faixa de -10 - 40 °C e uma umidade de 95 % UR ou menos a uma pressão atmosférica (1013 hPa).
Calibração	Ajusta as leituras para o valor do gás de calibração usando o gás de calibração.
Supressão zero	Uma função para cortar a flutuação específica que o sensor tem.
Tempo de atraso de alarme	Uma função que suspende temporariamente a ativação para evitar que um alarme falso seja causado por ruído a partir do exterior.
INHIBIT	A função de detecção do gás é suspendida temporariamente durante a manutenção, etc., do detector. A isto também se chama "avanço de ponto", que tem a mesma função.

Histórico de Revisão

Edição	Revisão	Data de emissão
0	Primeira edição (PT2E-1790)	05/13/2021
1	Declaração de conformidade	11/12/2021
2	P51,52,53 Capacidade de contato	05/30/2022
3	Declaração de conformidade	05/31/2024



EU-Declaration of Conformity

Document No. 320CE24094



We, RIKEN KEIKI Co., Ltd. 2-7-6, Azusawa, Itabashi-ku, Tokyo, 174-8744, Japan declare under our sole responsibility that the following product conforms to all the relevant provisions.


Product Name Smart Transmitter/Gas Detector Head
Model SD-10X, SD-1DOX, SD-1EC, SD-1DEC

Council Directives	Applicable Standards
EMC Directive (2014/30/EU)	EN 50270:2015
ATEX Directive (2014/34/EU)	EN IEC 60079-0:2018 EN 60079-1:2014
RoHS Directive (2011/65/EU[1])	EN IEC 63000:2018

^[1]Including substances added by Commission Delegated Directive (EU) 2015/863

EU-Type examination Certificate No.	DEKRA 13ATEX0035X
Notified Body for ATEX	DEKRA Certification B.V. (NB 0344) Meander 1051, 6825 MJ Arnhem P.O. Box 5185, 6802 ED Arnhem The Netherlands
Auditing Organization for ATEX	DEKRA Certification B.V. (NB 0344) Meander 1051, 6825 MJ Arnhem P.O. Box 5185, 6802 ED Arnhem The Netherlands

The marking of the product shall include the following:

 II 2 G Ex db IIC T6 Gb -20°C ≤ Ta ≤ +60°C

Alternative Marking: -

Place: Tokyo, Japan

Date: May. 24, 2024

Takakura Toshiyuki
General manager
Quality Control Center