


FP-31 簡易取扱説明書

各部名称

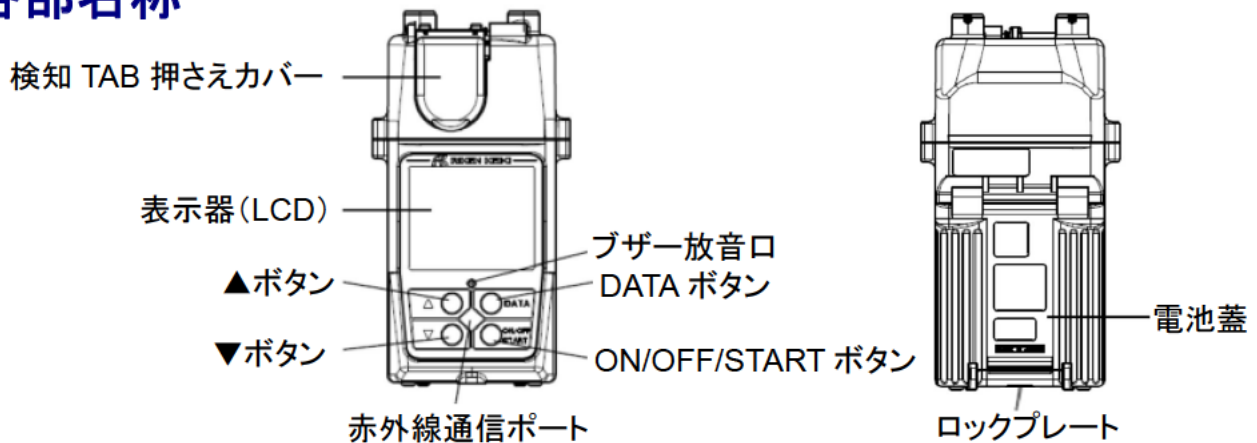

検知 TAB の装着

1.検知 TAB 押さえカバーを開く

2.検知 TAB を装着する

3.検知 TAB 押さえカバーを閉じる

中央部分をしっかりと指で押してください。



検知 TAB 装着時の注意

検知 TAB を装着する際は、検知 TAB が下記の向きとなるように装着してください。

上面



下面



電池の装着

本器を初めて使用する場合や電池残量が少ない場合は、以下の手順で新品の単三アルカリ乾電池を装着または交換してください。

1.本体の電源が切れていることを確認する

電源が入っている場合は、[ON/OFF/START ボタン] を押して、電源を切ってください。

2.電池蓋を開ける

ロックプレートを開いて電池蓋のロックを外し、電池蓋を開けてください。



3.電池の極性に注意して、新しい電池を入れる

古い電池が入っている場合は、取り外してください。

4.電池蓋を閉める

電池蓋を閉め、ロックプレートを閉めてください。ロックプレートは、“カチッ”と音がするまでしっかりと閉めてください。




使用方法

電源を入れる前に「検知 TAB の装着」に沿って検知 TAB を装着してください。


1.電源の入れ方

ブザーがピッと鳴るまで[ON/OFF/START ボタン]を押し続けます(1 秒以上)。LCD 表示が全点灯し、各種情報が順次表示がされた後に、検知準備完了のメッセージが約 5 秒間表示されます。

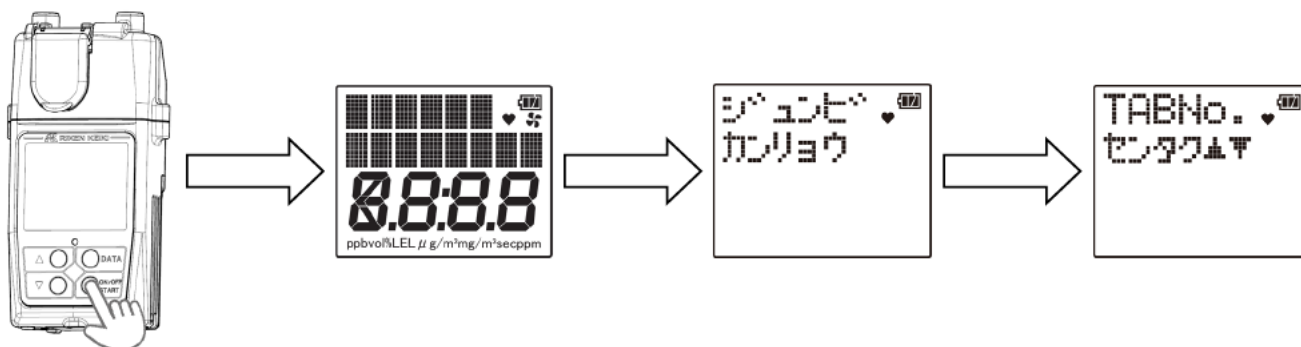

2.検知 TAB を選択する


[▲ボタン]または[▼ボタン]で選択してください。

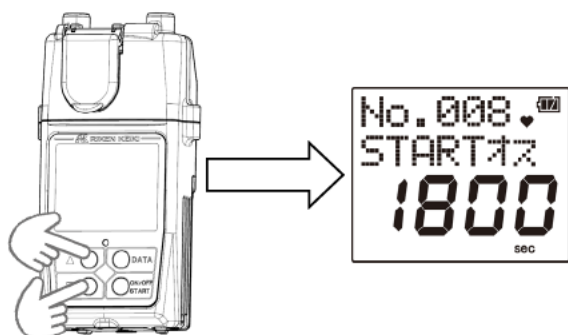

検知 TAB が装着されていない場合

検知準備完了のメッセージの表示後、以下画面が表示されますので、検知 TAB を装着してください。


装着後、TAB 選択画面に切り替わります。



3.ガス検知を行う

[ON/OFF/START ボタン]を押してください。検知時間(秒)がカウントダウンされます。

カウントダウン終了後に、検知結果の濃度が表示されます。検知が終了すると濃度値とメッセージが交互に表示されます。

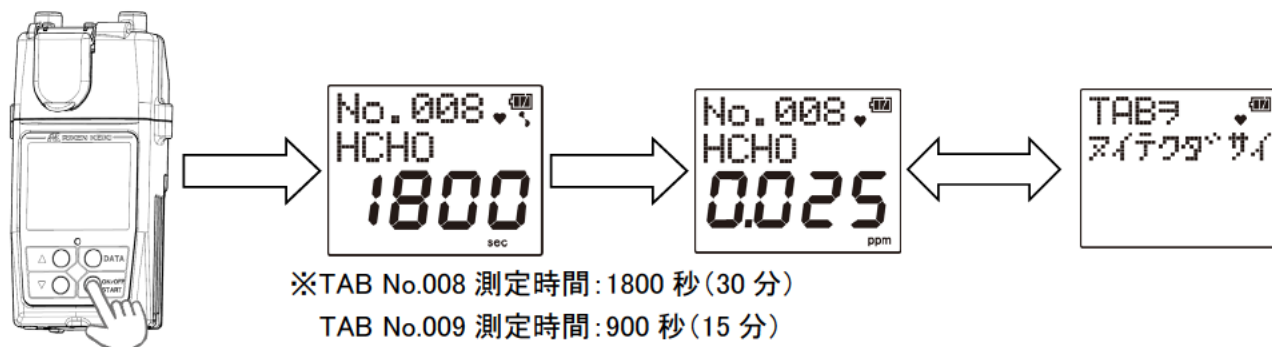

4.電源を切る

検知 TAB を取外し、ブザーがピッと 9 回鳴るまで[ON/OFF/START ボタン]を押し続けます(3 秒以上)。